

# Anleitungen zur Verwendung von RIFE-FREQUENZINSTRUMENTEN





**Einleitung: Hier sind zwei Artikel, die von Dr. Rifes Geschäftspartnern aus den 1950er Jahren, John Crane und John Marsh, für das Rife Virus Microscope Institute in den 1950er und 1960er Jahren verfasst wurden.**

**Der erste Artikel war ein Handbuch, das mit dem oben auf dem ersten Foto gezeigten Frequenzgenerator verschickt wurde. Es handelte sich um ein Kontaktinstrument, das zunächst metallische runde Scheiben verwendete, die schließlich durch Metallhandzylinder und Fußplatten ersetzt wurden. Es wurde hier verfügbar gemacht, sodass die Leute es lesen und ein gutes**

**Verständnis dafür gewinnen können, wie man Rife-Frequenzinstrumente benutzt.**

**Der zweite Artikel behandelt die Verwendung des Metall-Handzylinder-Kontaktinstruments, beinhaltet aber auch die Verwendung des RF-Strahlröhren-Neutralgeräts, das auf dem zweiten Foto oben zu sehen ist. Es behandelt Patienten und Laborversuchstiere und spricht über die Behandlungsdistanz von 1 bis 2 Fuß vom Strahlenrohr, innerhalb der sich Patienten und Tiere befinden sollten, um die größte Energieübertragung zu gewährleisten. Es wird erklärt, warum Patienten und Kontrolltiere, also solche, die man nicht behandeln lassen möchte, mindestens 25 Meter von der RF-Strahlenröhre entfernt gehalten werden müssen, sonst erhalten sie eine Behandlung. Diese Informationen zeigen eindeutig, dass der 1936er Rife Ray #5, der von der Beam Ray Corporation von 1938-39 verkauft wurde, eine Person in einem Abstand von 30 bis 60 Fuß vom Ray Tube behandeln konnte.**

**Beide Artikel sollten nicht als medizinische Beratung verstanden werden.**

## **ERSTER ARTIKEL.**


### **PROZESS ZUR DEVITALISIERUNG VON KRANKHEITSERREGERN**

## I. Elektronenübertragung


**A.** Das Rife Frequency Instrument überträgt Elektronen (Frequenzen) in Form von "positiven Elektronen" (oder "Positronen") bei variablen Frequenzen "von einer "Applikatorquelle".

1. Es gibt zwei Arten von Rife-Frequenzinstrumenten.

a. Ein großes Instrument, dessen "Applikatorquelle" aus einer Anode und einer Kathode besteht, die in einem Glasrohr [Strahlröhre, wie unten gezeigt] verborgen sind, umgeben von einem Heliumgasgemisch (oder einer inerten Gashülle).

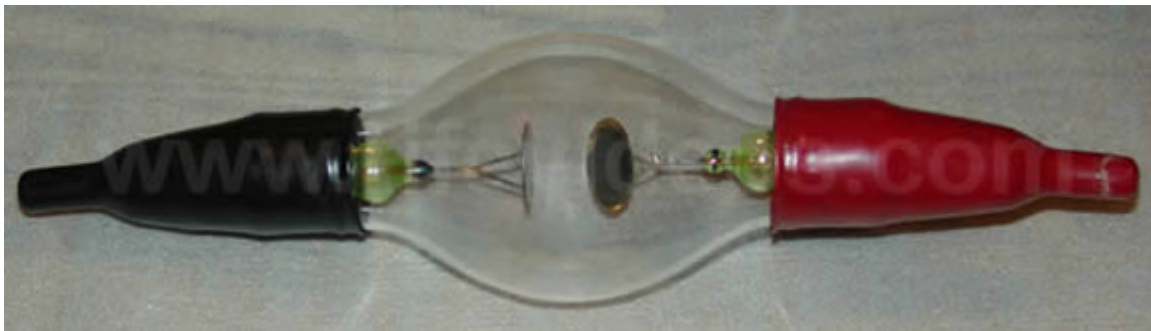

b. Ein kleines Instrument, dessen "Applikatorquelle" aus einer nackten Anode und Kathode besteht [Metallscheiben oder Metall-Handzylinder, wie unten gezeigt. Metall-Fußplatten werden ebenfalls verwendet] gefertigt aus (einem speziellen Typ) Metall für einen einfachen Übertragungsfluss von Positronen.

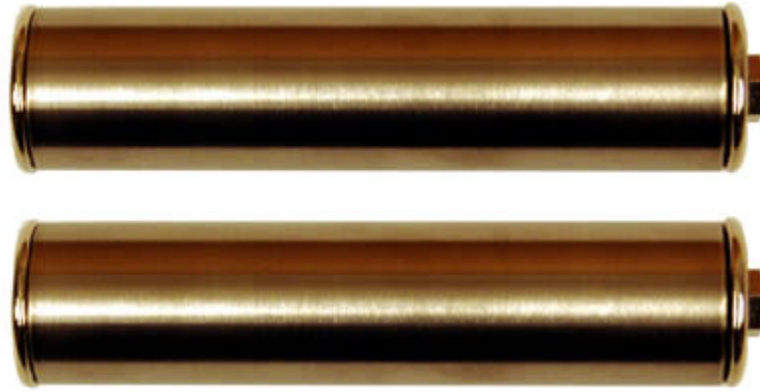

**B.** Die Elektronenübertragung, die in den Frequenzinstrumenten beteiligt ist, kann mit der Übertragung von Radioschallwellen von einem Funkgerät (und/oder akustisch) verglichen werden.

1. Eine Radiostation sendet hörbare Radioschallwellen, und ein Empfänger oder Empfangsinstrument (ein Radio) empfängt diese Wellen und wandelt sie in einen hörbaren Bereich für das menschliche Hören um.

a. Die von einer Radiostation übertragenen Radiowellen können an jedem Ort gehört werden, an dem das Sendeinstrument (das Radio) an eine Steckdose "angeschlossen" ist.

2. Das Rife-Frequenzinstrument überträgt Radioschallwellen; aber, abgesehen von zwei Fällen, sind diese Schallwellen für das menschliche Ohr nicht hörbar (außer mit einem Wandler).

a. Für sehr empfindliche Ohren sind sie hörbar, wenn die Anode vor einem Ohr und die Kathode vor das andere Ohr gelegt wird.

b. Diese Schallwellen sind zu hören, wenn ein Verstärker an das Frequenzinstrument angeschlossen ist.

1. Jede Frequenz hat, wenn sie hörbar ist, einen anderen Ton, Ton oder Klang.

2. Mit dem Verstärker kann der Schall so laut werden, dass die Kraft und Kraft des Schalls Objekte wie Glas usw. zerbrechen können, wenn er mit den Bestandteilen der betroffenen Materialien abgestimmt ist.

**C.** Das große Rife-Frequenzinstrument enthält eine variable "RF"-Trägerfrequenz (Radiofrequenz) und einen Audiofrequenzgenerator, der über Drähte an eine Applikatorröhre angeschlossen ist. Das kleine Instrument verwendete ausschließlich Audiofrequenzen.

1. Wenn entweder die Senderöhrenantenne für das (große Instrument) oder die nackte Anode und Kathode (kleines Instrument) verwendet werden, wird die harmonische Totschwingungsrate jeder elektromagnetischen Energie (oder die koordinative Resonanz mit den chemischen Bestandteilen des mikrolebenden Organismus) durch Drehen des Instruments auf die richtige Einstellung eingestellt, wodurch der "Erreger" (mikrolebende Organismen) devitalisiert wird.

A. Die pränatale Bakterienzelle und die pränatale Zelle des Virus werden durch eine übermäßige "Raumladung" positiver Elektronen (oder Positronen) zerstört. Dies ist eine Funktion der Zeit mit Energie (Frequenzen), die den zu devitalisierenden Mikroorganismus bombardiert.

1. Bei Verwendung der Transmissionsröhre [Strahlröhre] beträgt die

Raumladungskonzentration etwa 10 Zoll. **Mit anderen Worten: Der Abstand zwischen dem Rohr und dem Bereich des Körpers, auf den das Rohr gerichtet ist, sollte ein Abstand von 10 Zoll oder weniger betragen.** [Diese Distanz wurde mit dem ursprünglichen Instrument der 1930er/1950er Jahre verwendet, das eine Leistung von 50 Watt hatte. Wenn ein Instrument ein 100-Watt-Instrument ist, würde sich die Entfernung verdoppeln. Je mehr Leistung, desto größer ist die Entfernung der Person zum Strahlenröhrchen].

2. Wenn die nackte Anode und die Kathode verwendet werden, befindet sich diese Raumladungskonzentration zwischen Anode und Kathode – also dem Abstand, der zwischen ihnen in Kontakt mit dem Körper besteht. Die Energie wird zum Wohlbefinden des Patienten kontrolliert.

## **II. Kalibrierung der Frequenzen**

**A.** Dr. Royal Raymond Rife kalibrierte die Frequenzen im Rife-Frequenzinstrument ursprünglich mit reinen Kulturen pathogener Krankheiten auf Objektträgern unter dem Rife-Virusmikroskop. (Lesen Sie "The Rife Microscope or facts and Their Fate" Nachdruck Nr. 47. Lee Stiftung für Ernährungsforschung, Milwaukee, Wisconsin).

1. Das Rife Virus Microscope Institute kalibriert diese Instrumente derzeit mit Hilfe eines speziellen Frequenzzählers. Dieser Prozess ist heute möglich, weil Dr. Rife viele Jahre im Labor verbrachte, um die tödliche Schwingungsrate vieler pathogener

Krankheiten zu erfassen, teils mit Kollegen und in anderen Fällen allein. Mit moderner Ausrüstung kann RVMi nun die Kalibrierungsgenauigkeit der Instrumente aufrechterhalten.

### **III. Prozess der Eliminierung devitalisierter "Kausalwirkungen"**

**A.** Nachdem die mikrolebenden Organismen devitalisiert sind, entzieht das Lymphsystem des Körpers, das wie ein Vakuumpfeiger arbeitet, die zerstörten Partikel aus den devitalisierten Bereichen und transportiert sie durch den Blutkreislauf zu den Urinal- und/oder rektalen Eliminationskanälen und aus dem Körper.

1. Der Körper, der dann frei von dem Erreger einer bestimmten Krankheit ist, erhält die Möglichkeit, die zerstörten oder beschädigten Zellen entsprechend dem durch den Erreger verursachten Schaden und anderen beteiligten Faktoren wieder aufzubauen.

### **IV. Notwendige Pflege während und/nach einem Devitalisierungsprozess**

**A.** Bei Krankheiten mit langjähriger Krankheit, mit niedrigem Stoffwechsel und sehr schlechtem körperlichen Zustand ist es manchmal notwendig, Medikamente wie Medikamente, Blutplasma, zugesetzte Vitamine durch intravenöse Injektionen und Bluttransfusionen einzusetzen.

1. Diese ernsteren Maßnahmen sind notwendig, wenn der körperliche Zustand des Patienten

ernsthaft beeinträchtigt ist.

2. In jedem Fall sind ausreichende Ruhe und eine ausgewogene Ernährung äußerst notwendig, um den wertvollen Körperzellen zu helfen, eine durch die Zerstörung von Virus, Pilzen oder Bakterien verursachte Schwäche zu überwinden.

a. Es sollte stets daran gedacht werden, dass die Natur einen Zustand des langjährigen "Übernachts" nicht auslöschen kann.

b. Wenn eine Krankheit seit langem besteht (zum Beispiel seit acht Monaten oder länger), muss eine Person zwei wichtige Faktoren im Hinterkopf behalten.

1. Die Krankheit schädigt und zerstört Zellen, nicht nur seit der Entdeckung und Diagnose der Krankheit, sondern auch für einen Zeitraum davor. Im Fall von Krebs kann die Vorerkennungsdauer beispielsweise bis zu fünf Jahre betragen.

2. In vielen Fällen wurden bereits vor dem Einsatz des Rife Frequency Instruments Krankheitsmittel verschiedener Art eingesetzt. Diese Mittel könnten eher schädlich als hilfreich für den Körper gewesen sein.

c. Es sollte nicht angenommen werden, dass diese Krankheiten mit dem Einsatz des Rife-Frequenzinstruments sofort beseitigt werden. Es muss Zeit eingeräumt werden, damit sich der Körper wieder aufbauen kann, und eine angemessene Pflege ist entscheidend für die Wiedererholung guter Gesundheit.

## V. Toxine und ihre Wirkung

**A.** Nachdem eine oder mehrere Frequenzsätze in die betroffenen Bereiche übertragen wurden, entstehen oft Toxine durch den Devitalisierungsprozess.

1. Das Vorhandensein dieser Toxine verursacht oft für kurze Zeit Schmerzen im Körper, meist in dem Bereich, in dem der Devitalisierungsprozess stattgefunden hat. Das Vorhandensein dieser Toxine führt jedoch nicht IMMER zu Schmerzen.

a. Der Grund für die Unterschiede in der Reaktion von (1) verschiedenen Personen und (2) derselben Person während unterschiedlicher Zeiträume ist folgender:

1. Wenn der Körper im Ausscheidungsprozess normal funktioniert, verursachen die Toxine keine Schmerzen.

2. Wenn der Körper im Ausscheidungsprozess NICHT normal funktioniert, führen die Toxine im Vergleich zu einer kurzen Schmerzphase. Zum Beispiel im tatsächlichen Fall einer Verletzung am linken Knie einer Frau: Die Folgen der Verletzung zeigten sich in einem Schmerz, den sie täglich und vier Jahre lang ununterbrochen erlitt. Nach dem dritten Einsatz des Rife-Frequenzinstruments erlitt sie eine Schmerzphase. Diese Reaktion war schwerwiegender als jeder Schmerz, den sie durch die Verletzung selbst in den vorangegangenen vier Jahren erlitten hatte. Beachten Sie jedoch die kurze Dauer. Dieser Fall ist mit fast allen anderen dokumentierten Fällen vergleichbar.

b. Auch wenn sie im Allgemeinen kurz ist, sollte man sich der Möglichkeit der oben beschriebenen Reaktion bewusst sein, damit ihr tatsächliches Auftreten nicht fälschlicherweise als durch die Krankheit verursachte erhöhte Schmerzen interpretiert wird.

c. Ursprünglich wird der durch die Krankheit selbst verursachte Schmerz unmittelbar nach dieser kurzen Phase verstärkter Schmerzen durch die Toxine erheblich gelindert und lässt weiter nach, bis er vollständig verschwunden ist.

d. Dieser gesamte Prozess variiert natürlich je nach Alter, allgemeiner Gesundheit, richtiger oder ungeeigneter Durchblutung; normale oder schlechte Darm- und Urinausscheidung, normale oder schlechte Funktion des Lymphsystems.

e. Wenn diese Bedingungen günstig sind, werden die Toxine und die devitalisierenden Partikel des Erregers ohne ein spürbares Schmerzgefühl im Zusammenhang mit diesem Eliminierungsprozess entfernt. Mit anderen Worten: Die Intensität oder das Ausbleiben von Schmerzen in dieser Hinsicht hängt von den oben in "d" genannten Bedingungen ab.

## **VI. Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen nach einer langanhaltenden Krankheit**

**A.** Es ist notwendig sicherzustellen, dass eine Person, deren Körper durch eine oder mehrere schwerwiegende Krankheiten geschwächt wurde, zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen bezüglich ihrer Gesundheit trifft, selbst nachdem die Erreger

dieser Krankheit oder deren Krankheiten entvitalisiert wurden.

1. Wenn der Körper einer Person durch eine schwerwiegende Krankheit geschwächt wurde, wurden viele Körperzellen zerstört oder beschädigt.

a. Deshalb muss der Körper ZEIT haben, um seine Kraft und Widerstandsfähigkeit durch ausreichende Ruhe, eine ausgewogene Ernährung usw. wieder aufzubauen. Diese Faktoren können nicht hoch genug betont werden, da sie UNERLÄSSLICH für den Wiederaufbau des Körpers in einen guten Gesundheitszustand sind.

b. Solange ZEIT und NATUR diese Möglichkeit nicht hatten, wäre der Körper anfälliger für andere schwere Krankheiten als unter normalen Umständen.

1. Zum Beispiel, wenn eine Person sich in diesem geschwächten Zustand eine Erkältung zuzieht; Eine Lungenentzündung konnte viel leichter auftreten als sonst. Daher sollte eine Person das Gerät nach einer schweren Krankheit bei einer Erkältung verwenden, auch wenn sie sich vielleicht keine Zeit nimmt, wenn der Körper vor der Erkältung gesund war und war.

Mit anderen Worten: Das Instrument kann und sollte JEDES Mal verwendet werden, wenn eine Person sich erkältet, aber es ist EXTREM wichtig, es zu verwenden, wenn der Körper sich noch von den Folgen einer schweren Krankheit erholt.

Dieses Beispiel gilt auch für andere Situationen ähnlicher Natur. TREFFEN SIE DOPPELTE VORSICHTSMASSNAHMEN, BIS DER KÖRPER WIEDER KRAFT UND WIDERSTAND ERLANGT HAT.

## **Allgemeiner Ablauf bei allen Krankheiten und auffälligen Zuständen**

### **I. Allgemeine Informationen zur Anode und Kathode**

**A.** Der Begriff "Anode" in diesen ANLEITUNGEN bezieht sich auf einen isolierten Draht und eine Sonde [Metall-Handzylinder], die an einem Ende davon befestigt sind. Der Begriff "Kathode" bezieht sich auf einen weiteren solchen Draht und eine Sonde [Metall-Handzylinder].

1. Die Definition von "Anode" lautet: der positive Pol oder die Elektrode eines Bauelements. Es ist die positive Elektrode, zu der die negativen Ionen wandern.

2. Die Definition von "Kathode" lautet: In einer Elektronentube handelt es sich um eine Elektrode, durch die ein primärer Elektronenstrom in den inneren Elektrodenraum eintritt. Im Wesentlichen wird sie allgemein als negative Elektrode bezeichnet.

3. Im Fall des Rife-Frequenzinstruments [dem Typ, der keine Strahlröhre verwendet] werden ein Draht und eine Sonde [Metall-Handzylinder oder Fußplatte] zur "Anode", wenn sie in die Öffnung des Ausgangs eingesteckt werden.

4. Der andere Draht und die Sonde [Metall-Handzylinder oder Fußplatten] werden zur "Kathode", wenn sie in die Öffnung des Ausgangs eingesteckt werden.

5. Mit anderen Worten: Der Mechanismus im Instrument selbst ist dafür verantwortlich, dass ein Draht als positiver Pol (Anode) und der andere als negativer Pol (Kathode) reagiert.

B. Beim Anlegen der Anode und der Kathode am Körper wird der Abstand zwischen ihnen durch die Art des erkrankten Bereichs bestimmt. Der Abstand zwischen Anode und Kathode variiert je nach Größe, Tiefe und Ort jeder spezifischen Erkrankung.

1. Im Folgenden sind allgemeine Anweisungen zur Platzierung von Anode und Kathode:

a. Wenn möglich, sollten Anode und Kathode so platziert werden, dass der Rand der "Anode" innerhalb von 2,5 cm von einer Seite des kranken Bereichs und der Rand der "Kathode" innerhalb von 2,5 cm von der anderen Seite des kranken Bereichs entfernt ist. Dies ist in den meisten Fällen bei Beulen, Warzen, Pilzen, Impetigo, Fußpilz, "Wens" (Lymphknoten) usw. möglich.

b. Wenn die Krankheit oder Erkrankung eher interner Natur ist, werden die Anode und die Kathode [Fußplatten] so platziert, dass die Übertragung der von ihnen ausgesendeten Frequenz einen "vollständigen Kreislauf" im infizierten Bereich erzeugt und nicht nur in der "Oberfläche". Wenn zum Beispiel der Arzt des Patienten die Erkrankung als Tumor auf dem

Dickdarm nahe der linken Seite diagnostiziert hat, sollte die Anode und Kathode nicht einen Zoll auf beiden Seiten des kranken Bereichs platziert werden. Stattdessen werden auf jede Körperseite eines platziert, zentral zwischen Vorder- und Rückseite, direkt zum Tumor oder direkt über dem Tumor an der Vorderseite des Körpers und in einer Position auf der Rückseite, die mit der Lage des Tumors übereinstimmt. Auf diese Weise beeinflusst die Übertragung der Frequenz nicht nur den Oberflächenbereich des Tumors, sondern dringt vollständig in den Tumor ein.

c. Anode und Kathode müssen immer direkten Kontakt mit dem nackten Fleisch haben. Wenn einer oder beide Haare oder Kleidung berühren, wird der Stromkreis unterbrochen. [Wenn Frotteebezüge mit den Handzylindern oder Fußplatten verwendet werden, müssen diese feucht sein, damit sie leitfähig werden und die Frequenzen in den Körper gelangen].

## **Verfahren zur Bedienung des Instruments**

1. Drehen Sie den OUTPUT-Regler langsam nach rechts (im Uhrzeigersinn) auf ein "angenehmes Intensitätsniveau". Ein "angenehmes Intensitätsniveau" wird erreicht, wenn der Regler im Uhrzeigersinn zu einer Position gedreht wird, die ein "Kribbeln" oder "Kribbeln" im unmittelbaren Bereich einer der Sonden [Metallhandzylinder oder Fußplatten] erzeugt.

**Hinweis:** [Wenn eine HF-Trägerfrequenz verwendet wird, gibt es kein "Kribbeln" oder

"Kribbeln", da die HF-Trägerfrequenz oder die Zyklen pro Sekunde zu schnell für den Körper sind. Instrumente, die eine HF-Trägerfrequenz verwenden, können bis zu 150-mal mehr Leistung oder Energie liefern als der ursprüngliche Frequenzgenerator mit diesen Befehlen].

a. Dieses Gefühl muss keine unangenehme Intensität haben, um wirksam zu sein. Eine Person muss sich nur eines leichten "Kribbelns" oder "Kribbelns" bewusst sein.

b. Wenn während der Zeit, in der die Sonden [Metall-Handzylinder oder Fußplatten] mit dem Körper in Kontakt sind, dieses "Kribbeln" unangenehm verstärkt wird, sollte der OUTPUT-Regler schnell nach links (gegen den Uhrzeigersinn) und dann wieder langsam nach rechts (im Uhrzeigersinn) gedreht werden, bis ein "angenehmes Intensitätsniveau" wieder erreicht ist.

c. Eine Person wird keine negativen Auswirkungen von der erhöhten Intensität haben. Die vom Rife Frequency Instrument übertragenen Frequenzen liegen im Audioband, das zu niedrig ist, um menschliche Zellen zu schädigen. [[Dr. Rifés ursprüngliche Frequenzen liegen im hohen HF-Bereich und schaden auch den menschlichen Zellen nicht](#)]. Der Grund, den Regler schnell nach links zu drehen, ist lediglich, Unbehagen zu vermeiden.

d. Der Grund, warum ein Kribbeln stärker wird, ist, dass die Nervenzentren nach der Übertragung der Frequenzen für eine bestimmte Zeit stärker als normal aktiviert werden, weil die Zellen des

Nervenzentrums selbst reaktiviert werden. Diese Reaktivierung wird durch das "Anregen" der Elektronen (in den Zellen enthalten) verursacht, bedingt durch die von den Elektronen übertragene Kraft, die vom Instrument in diesen Bereich übertragen wird.

e. Normalerweise tritt dieses "Kribbeln" nur im Bereich einer Sonde (der Anode), [Metall-Handzylinder oder Fußplatte] auf, aber gelegentlich spürt man ein "Kribbeln" sowohl von der Anode als auch von der Kathode. Der Grund dafür ist, dass sich in diesem Bereich des Körpers ein Nervenzentrum befindet, das näher an der Oberfläche liegt als an anderen Kontaktpunkten. Zur weiteren Klarstellung: Wenn sich ein Nervenzentrum nahe der Oberfläche befindet, im betroffenen Körperbereich, gibt es ein Kribbeln sowohl im Bereich der Kathode als auch im Bereich der Anode. Wenn die Sonden [Metallhandzylinder] an Stellen platziert werden, an denen ein Nervenzentrum nicht so nah ist, entsteht ein Kribbeln nur im Bereich der Anode.

f. Ein weiterer Grund für diese doppelte Empfindung ist, dass die Elektronen gelegentlich von einer Sonde zur anderen reisen, aufgrund der Beschaffenheit der bestimmten chemischen Bestandteile der betroffenen Zellen.

**Vorgeschlagene Platzierung von Anode und Kathode bei bestimmten Krankheiten und auffälligen Zuständen**

**A.** "1" zeigt entweder die Anode oder die Kathode an. "2" zeigt entweder die Anode oder die Kathode an.

1. Mit anderen Worten: Es ist egal, welche Sonde [Metall-Handzylinder oder Fußplatten] für jede der beiden Positionen verwendet wird. Zum Beispiel ist die Wirksamkeit gleich, egal ob die Anode links im kranken Bereich und die Kathode rechts liegt, ODER ob die Kathode links und die Anode rechts liegt. Daher werden die Positionen der Sonden als "I" und "II" und nicht als "Anode" und "Kathode" bezeichnet.

**B.** Der gesamte Bereich der Anode und Kathode ist, wenn möglich, mit dem Fleisch in Kontakt.

**C.** Wenn zwei Platzierungen für die Sonden angegeben sind, können sie, wenn gewünscht, mit einer Reihe von Devitalisierungsprozessen abwechselnd durchgeführt werden.

Standort und Platzierung der Sonden

**ANUS:** "1": Der innere Rand der Sonde sollte einen Zoll links vom Anus (am linken Gesin) liegen.  
"2": Der innere Rand der Sonde sollte einen Zoll rechts vom After liegen (am rechten Gesäß).

**ARM:** "1": Oben am Arm oder einfach "über der Spitze" am äußersten oberen Teil des Rückens.  
"2": In der Handfläche halten, die Finger leicht auf die freiliegende Seite der Sonde drücken.

Im Fall einer Lähmung beider Arme (Staphylokokken oder eine andere Erkrankung, die

beide Arme betrifft) wird häufig folgendes Verfahren angewendet.

"1": Halte die Sonde in der Handfläche der linken Hand.

"2": Halte die Sonde in der Handfläche der rechten Hand.

**ARSELHÖHLEN:** "1": Links vom Lymphknoten einen Zoll. "2": Rechts vom Lymphknoten einen Zoll.

**BLASE:** "1": Auf der linken Körperseite (zentriert in der "Dicke" des Körpers) in direkter Linie zur Blase. "2": Auf der rechten Seite an einer vergleichbaren Stelle ODER "1": Direkt über der Blase vorne. "2": Direkt "in einer Linie" mit der Blase auf dem Rücken.

**Blut:** "1": Da die Blutkrankheit (Leukämie) den ganzen Körper bedeckt, wird Sonde "1" auf der linken Körperseite platziert. "2": In einer vergleichbaren Position. Wenn die Zeit es erlaubt, beginnen Sie an den Schläfen und platzieren Sie die Sonden in etwa drei Zoll Abständen bis zum Schritt. Dann setze eine Sonde oben am linken Bein und auf den Ballen des linken Fußes und wiederhole das mit dem rechten Bein.

Wenn die Zeit diese umfangreiche Abdeckung nicht zulässt, verwenden Sie so viele Positionen, wie es die Zeit erlaubt, und beziehen Sie immer den Brustbereich ein.

**FUSPILZ:** Infizierter Bereich zwischen den Zehen, "1": An der Seite des kleinen Zehs. "2": An der Seite des großen Zehs.

Infizierter Bereich Fußballen oder flacher Bereich,  
"1": Auf der Seite des Fußes, direkt "in Linie" mit dem betroffenen Bereich. Fußballen oder flacher Bereich "2": Auf der gegenüberliegenden Fußseite, direkt "in Linie" mit dem betroffenen Bereich und mit "1".

[Heute benutzen die Menschen Fußplatten und legen ihren linken Fuß auf eine Platte und den rechten Fuß auf die andere. Das deckt das gesamte Gebiet ab, ohne dass man es auf die alte Weise machen muss.

**NASE:** "1": Auf der linken Wange, nahe der Nase.  
"2": Auf der rechten Wange, nahe der Nase.

**OVERYS:** Rechts oder links: "1": Auf der Vorderseite des Körpers eine Sonde über den betroffenen Eierstock legen. "2": Auf der Rückseite des Körpers direkt hinter dem betroffenen Eierstock, sodass der Eierstock in einer direkten Linie zwischen den Sonden liegt.

**VARICOSE Venen:** Zwischen Knie und Knöchel,  
"1": Am Knie. "2" am Knöchel – mit der Krampfader in direkter Linie mit "1" und "2".

[Heute benutzen die Menschen Fußplatten und legen ihren linken Fuß auf eine Platte und den rechten Fuß auf die andere. Das deckt das gesamte Gebiet ab, ohne dass man es auf die alte Weise machen muss.

Die oben genannten "spezifischen Platzierungen" sind mit anderen Krankheiten und abnormen Bedingungen vergleichbar, was die Platzierung von Anode und Kathode [Metall-Handzylinder oder

Fußplatten] für die besten Ergebnisse betrifft. Die allgemeine Regel, die man sich merken sollte, lautet: Stellen Sie immer sicher, dass der kranke Bereich direkt zwischen Anode und Kathode liegt. DAS IST EIN MUSS.

## **Preliminary Instructions Concerning "CHART FOR DISEASES AND ABNORMAL CONDITIONS"**

**A.** Ein Asterisk (\*) links von jeder spezifischen Krankheit oder abnormalen Erkrankung, die in der Tabelle aufgeführt ist, zeigt an, dass die Krankheit oder der Zustand positiv anspricht, wenn das Instrument so oft wie täglich verwendet wird. Wenn die Krankheit oder der Zustand ein Sternchen zeigt und ebenfalls unterstrichen ist, bedeutet das, dass das Instrument dreimal täglich verwendet werden kann (oder zweimal, wenn es praktischer ist).

Drei Sternchen (\*\*\*) zeigen an, dass die Krankheit oder die Erkrankung positiv anspricht, wenn das Instrument alle drei Tage oder zweimal pro Woche verwendet wird. Eine Asterisk- und eine Drei-Asterisk-Erkrankung können am selben Tag behandelt werden.

**B.** Im Folgenden finden sich die bestimmenden Faktoren für die empfohlene Zeit für das Anbringen von Anode und Kathode am Körper.

1. Wenn der Abstand zwischen Anode und Kathode neun Zoll oder weniger beträgt, werden Anode und Kathode für jeweils drei Minuten pro Frequenz angewendet.

2. Wenn der Abstand zwischen Anode und Kathode mehr als neun Zoll beträgt, wird die Anodekatode für fünf Minuten pro Frequenz angewendet.

**C.** Stellen Sie sicher, dass bei der Frequenz für T.B. (Tuberkulose) auch die Frequenz für das T.B.-Virus verwendet wird. Es ist unerlässlich, dass die beiden Frequenzen zusammen verwendet werden. Das Nichtanwenden beider Einstellungen kann zu übermäßiger Giftstoffzufuhr im Körper führen, was unerträglich ist.

**Abszesse \***

**Akne \***

**Arthritis \***

**Asthma \***

**Fußpilz \***

**Bacillus coli \***

**Blutungen \***

**Beulen \***

**Bronchialpneumonie \***

**Bronchitis \***

**Beulenpest \*\*\***

**Bursitis \***

**Schmetterlingslupis \***

**Karzinom \*\*\***

**Katarakt \***

**Katarrhalsekrete \***

**Erkältungen \***

**Koronare Thrombose \***

**Verstopfung \***

**Kontagöse Bindehautentzündung**

**Verstopfung \***

**Koronare Thrombose \*\*\***

**Koronarflattern \*\*\***

**Koronarleckage \*\*\***

**Mukoviszidose \*\*\***  
**Zystitis \*\*\***  
**Zysten \***  
**Dermatitis \***  
**Diphtherie \***  
**Elefantitis \*\*\***  
**Myomtumoren \*\*\***  
**Fibrom \*\*\***  
**Fistel \***  
**Grippe \***  
**Pilz \***  
**Glanders \***  
**Glaukom \***  
**Gonorrhö \***  
**Wucherungen \*\*\***  
**Verhärtung der Arterien \***  
**Heuschnupfen \***  
**Hämorrhoiden \***  
**Hernie \***  
**Impetigo \***  
**Infektion \*\*\***  
**Unregelmäßigkeiten der Menstruation \***  
**Reizungen \***  
**Juckreiz \***  
**Kehlkopfeentzündung \***  
**Lepra \***  
**Leukämie \***  
**Lymphknoten \***  
**Migränekopfschmerzen \***  
**Muttermale \***  
**Multiple Sklerose \*\*\***  
**Muskelschmerzen \***  
**Schmerzen \***  
**Parese \***  
**Magenmagen \***  
**Hämorrhoiden \***

**Bindenhautentzündung \***

**Ptergium \***

**Lungenentzündung \***

**Gift-Eiche \***

**Giftefeu \***

**Poliomyelitis \***

**Postnasal-Tropf \***

**Pyorrhoe \***

**Ausschlag \***

**Rheumatisches Fieber \***

**Rheuma \***

**Sarkom \*\*\***

**Sklerodermie \***

**Gürtelrose \***

**Nasenhöhlen \***

**Hautausbrüche \***

**Spinale Meningitis \***

**Staphylokokken \***

**Stiees \***

**Streptokokken \***

**Schwellung \***

**Tuberkulose \* Tuberkulosevirus \***

**Tetanus \***

**Grabenmund \***

**Treponema \***

**Tumore \***

**Typhus \***

**Ulcerierter Darm \*\*\***

**Geschwüre \***

**Talfieber \***

**Krampfadern \***

**Warzen \***

**Gelbgelbheit \*\*\***

**A.** Die "drei Sternchen"-Typen decken in der Regel eine größere Körperfläche ab und beeinträchtigen den Blutkreislauf stärker. Die "Belastung" auf das Lymphsystem bei diesen Typen ist in der Regel viel größer, bedingt durch (a) eine größere Menge devitalisierter Mikroorganismen und (b) eine größere Menge an Toxinen.

**B.** Da das Lymphsystem die devitalisierten Mikroorganismen und Toxine transportieren muss, muss es eine dreitägige Phase statt nur eines Tages erhalten, bevor das Instrument erneut für dieselbe Krankheit oder abnormale Erkrankung verwendet wird.

1. Wenn dieser Devitalisierungsprozess öfter als alle drei Tage angewendet würde, könnte das Lymphsystem mit devitalisierten Mikroorganismen und Toxinen "überlastet" werden, was zu einer übermäßigen Schmerzmenge führen würde; Daher muss genügend Zeit eingeräumt werden, um das Lymphsystem zwischen diesen Devitalisierungsprozessen zu "reinigen". [Viele Menschen können diese Erkrankungen alle zwei Tage (statt alle drei Tage) behandeln, wenn sie keine negativen "Überlastungs"-Reaktionen haben. Jede Person muss also ihre eigene Situation einschätzen].

2. Es ist wichtig zu erkennen, dass nach Beginn einer Reihe von Behandlungen diese mit treuer Regelmäßigkeit fortgesetzt werden sollte. Dies ist unerlässlich, da die vom Instrument ausgesendeten Frequenzen auf die Zelle des Mikroorganismus trainiert werden und diese zerstörerischen Substanzen devitalisieren können,

wenn sie dieses bestimmte Stadium erreicht haben, ABER diese Frequenzen werden nicht auf die chemische Entwicklungsstufe trainiert, die im Körper stattfindet und diese prämodalen Zellen hervorbringt. Da "die Erreger der Krankheit" ständig von einer Entwicklungsstufe in eine andere wechseln und nur diese eine Stufe vom Instrument beeinflusst wird, muss das Instrument regelmäßig verwendet werden, bis alle chemischen Ungleichgewichte (bezogen auf die spezifische Erkrankung, die Sie zu korrigieren versuchen) normalisiert sind. [Krebspatienten müssen verstehen, dass sie selbst wenn sie irgendwann eine saubere Gesundheit bekommen, immer anfällig für diese Krankheit sein werden und mindestens einmal pro Woche eine Erhaltungsbehandlung für den Rest ihres Lebens machen sollten, sonst könnte die Krankheit zurückkehren].

3. Es ist auch bedeutsam, dass der Blutkreislauf sowie die Zellen des Körpers mit den "Krankheitserregern" kontaminiert sind, weshalb die planmäßige Anwendung des Instruments unerlässlich ist, um (a) beim Aufbau der Zellen zu helfen und (b) den Blutkreislauf zu reinigen.

4. Es ist also offensichtlich, dass die Regelmäßigkeit der Behandlung ein sehr wichtiger entscheidender Faktor für die Dauer ist, die benötigt wird, um die "aktuelle" Ursache einer bestimmten Krankheit oder Erkrankung vollständig zu devitalisieren.

**C.** Obwohl das "Drei-Sternchen"-System gilt, kann das "Ein Sternchen"-System auch anderswo

verwendet werden, außerhalb des Gebiets, in dem die Drei-Tage-Frist abgelaufen ist.

BEISPIEL: Wenn das Instrument zur Entfernung eines Karzinoms der Lunge (ein "Drei-Sternchen"-Typ) eingesetzt wird, könnte das Instrument täglich für ein Gesichtsabfurst (ein "ein Sternchen"-Typ) verwendet werden.

**D.** Jede spezifische Krankheit, die bei einer beliebigen Anzahl von Menschen vorkommt, kann mit derselben Anzahl von Häufigkeiten, gleicher Anzahl von Fällen, gleicher Zeit (in Minuten) und mit derselben Regelmäßigkeit dem Devitalisierungsprozess unterzogen werden, und dennoch kann jede Person anders reagieren als alle anderen Menschen hinsichtlich der Erholungsdauer, Schmerzlinderung, Giftreaktion usw.

1. Der Grund dafür ist, dass das chemische Ungleichgewicht, das das Auftreten von Krankheiten verursacht, bei jedem Einzelnen in seinem Ausmaß der Abnormität variiert. Es gibt auch weitere Faktoren, darunter die allgemeine Gesundheit jedes Einzelnen, die Menge an Ruhe und angemessene Nahrung, die er bekommt, die Menge an Anspannung und Sorgen – oder deren Fehlen – der er in dieser Zeit ausgesetzt ist, die Menge an Medikamenten, die er einnimmt (und die mögliche schwächende oder devitalisierende Wirkung, die sie auf den Körper haben könnten). Die Menge an Zusatzvitaminen, Mineralstoffen und Proteinen, die er einnimmt (falls vorhanden), und weitere Faktoren. All dies unterscheidet sich von Person zu Person.

2. Daher sollte es kein Grund zur Besorgnis geben, wenn man feststellt, dass die günstige Reaktion und Erholung oder Erholung in seinem speziellen Fall "langsamer" sind als in einem anderen ähnlichen Fall, mit dem er vertraut ist. Dies ist eine Situation, die auch bei medizinischer Behandlung, Chiropraktik, Osteopathie, Physiotherapie usw. auftritt.

3. Immer im Hinterkopf behalten, dass in jedem einzelnen Fall zahlreiche Faktoren eine Rolle spielen; und daher reagiert jeder Fall unterschiedlich. Diese kombinierten Faktoren bilden genau den Grund, warum spezifische Ergebnisse durch die Nutzung des Rife-Frequenzinstruments nicht garantiert werden können, genauso wie ein Arzt oder Mitglied einer der oben genannten Heilkünste keine spezifischen Ergebnisse aus ihrer Behandlungsform garantieren kann.

a. Die Funktion des Instruments besteht darin, die Erreger bestimmter Krankheiten und Zustände zu devitalisieren. Zeit, Natur und Körper müssen den Rest erledigen.

## **Verwendung des VOLLBANDS**

Die obige Liste der Erkrankungen zeigt die individuellen spezifischen Krankheiten und abnormalen Zustände. Allerdings kann das VOLLE BAND [Alle Frequenzen von Rife] bei jeder Krankheit oder Erkrankung verwendet werden, wenn gewünscht.

1. Es gibt einen Vorteil und einen Nachteil, das VOLLE Bandbreite der Rife-Frequenzen zu verwenden.

a. Vorteil: Durch die Verwendung des VOLLBANDS werden alle Frequenzen auf den Körper angewendet, statt der drei bis sieben einzelnen Frequenzen, die im Horoskop vorgeschrieben sind, je nachdem, welche Krankheit oder Erkrankung Sie beeinflussen möchten.

BEISPIEL: Durch die Verwendung des VOLLBANDS für Nasennebenhöhlenentzündungen wären anstelle der üblichen Frequenzen alle Frequenzen, die das Instrument aussenden kann, wirksam.

Da Anode und Kathode bei einer Nasennebenhöhlenentzündung an derselben Stelle im Gesicht platziert sind, wie bei vielen anderen Krankheiten und Erkrankungen, die mehr oder andere Frequenzen erfordern würden (wie Ohrpilze, Ohrensaus, Kopferkältung usw.), würden solche Erkrankungen, falls vorhanden, gleichzeitig mit der Nasennebenhöhlenentzündung beeinträchtigt werden, wenn das VOLLE Frequenzband verwendet wird.

Dann können auch Erkrankungen vorliegen (in den frühen Stadien), von denen man sich noch nicht bewusst ist, weil keine Schmerzen oder Symptome aufgetreten sind. Solche Bedingungen würden auch beim Einsatz des VOLLN Frequenzbands beeinflusst.

b. Nachteil: Wenn das volle Band verwendet wird, ist in der Regel eine zweite Person erforderlich, um

das VOLLBAND-Zifferblatt zu drehen. Es ist sehr einfach, dass eine Person das Instrument allein benutzt, wenn man bestimmte Drehscheibeneinstellungen verwendet. Es ist jedoch schwieriger und in bestimmten Bereichen des Körpers fast unmöglich, das Instrument allein zu benutzen, wenn das VOLLE Band verwendet wird. [Diese Aussage stimmte, als John Marsh dieses Papier schrieb, aber dank der heutigen modernen Elektronik ist es heute möglich, einen Frequenzgenerator ohne eine zweite Person zu betreiben.]

Ein weiterer Faktor bei der Verwendung des VOLLBANDS der Rife-Frequenzen ist, dass die spezifischen Frequenzen, die für die Devitalisierungsprozesse vorgeschlagen werden, nur so oft übertragen werden wie alle anderen Frequenzen im Band. Angesichts dieser Tatsachen hat es sich als zufriedenstellend erwiesen, die Verwendung der spezifischen Frequenzen des VOLLBANDS während einer Reihe von Devitalisierungsprozessen abzuwechseln.

## **Kopferkrankheiten**

Einleitung: In allen Fällen von Kopferkrankungen müssen die Anode und die Kathodensonden jeweils eine auf jeder Seite des Kopfes platziert werden, sodass der kranke Bereich zwischen dem Fluss der durch die Anode übertragenen effektiven Frequenzen und der Kathode durch den Kopf liegen kann. Dadurch ist eine vollständige Schaltung möglich, sodass die auf das Instrument abgestimmten Frequenzen für die spezifische

Erkrankung des Kopfes entschärft werden können.

Diese Methode wird im ganzen Körper angewendet. Der Abstand von Anode und Kathode kann bei Wachstum nach Abstand reguliert werden; Zum Beispiel ein "Wen" (Lymphknoten), Beulen, Zysten, pustelartige Akne, Staphylokokken, Ausbrüche oder Hautabschürfungen, Zahnfleisch tuberkulose, Grabenöffnung, Pyorrhoe, Mukoviszidose, Magengewüre, Impetigo, Ohrkrebs, Ohrgeräusche, Ohrpilz, Migränekopfschmerzen, postnasaler Tropf, Nasennebenhöhlen, Hirntumore, katarrhale Sekretionen, Glaukom, Katarakt, Muttermale, Schmetterlingslupus, Erkältungen, Grippe, Neoplasien, Warzen und viele andere ähnliche Kopferkrankungen.

Der Abstand zwischen Anode und Kathode ist, wenn es passt, innerhalb von einem Zoll vom äußeren Kreis der Anode und Kathode auf jeder Seite des kranken Bereichs platziert. Dies wird natürlich vor Ort bestimmt. Im Falle eines Siedes auf der Nase, wobei die Anode und die Kathode einen Zoll vom äußeren Rand des Boils entfernt platziert werden, wobei das Boil direkt dazwischen liegt. In einem solchen Fall können Anode und Kathode flach an der Wange oder an der Gesichtsseite platziert werden, wodurch die Übertragung der Frequenz durch den infizierten Bereich gelangt, wodurch die Krankheit abnimmt und durch die Devitalisierung des Erregers wieder austritt. Beachten Sie immer, dass die Anode oder Kathode stets mit der nackten Haut in Kontakt kommen darf und keine Kleidung, weder Haare noch Stoff, berühren darf, da die Übertragung durch diese Materialien nicht effektiv erfolgen

kann. Diese Gegenstände wären die Ursache dafür, dass der vom Instrument in die Kathode übertragene Stromkreis unterbrochen wird, der durch die Anode, die negative Ladung oder umgekehrt entsteht. [Denken Sie daran: Wenn Frotteeabdeckungen mit Anode und Kathode verwendet werden, müssen diese feucht sein, damit die Frequenzen in den Körper gelangen]

Denken Sie stets an den Komfort der Person, die die Behandlung bekommt. Dieser Komfort lässt sich am besten damit erklären, dass die Person in einer ruhevollen Position gebracht werden muss, indem sie Anode und Kathode an ihrem Kopf hält, während sie das Instrument an sich selbst benutzt, in diesen Positionen, die sich in etwa 30 Minuten oder länger nicht ermüden. Manchmal ist es notwendig, entweder Scotch-Tape, Maskierband oder Klebeband zu verwenden, um das Halten von Anode und Kathode an der richtigen Stelle zu erleichtern, während die Hände des Benutzers frei sind, um die notwendigen Regler einzustellen und zu drehen, um die Frequenzen einzustellen, die den Erreger der jeweiligen Krankheit devitalisieren. In jedem Fall, wie hier am besten erklärt, benutzt die Person das Instrument an sich selbst und ist verantwortlich, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen, um es nicht zu übertreiben. [Diese obige Aussage über das Zifferblatt stimmte, als John Marsh dieses Papier schrieb, aber aufgrund moderner Elektronik von heute sind keine Zifferblätter mehr nötig, um die Frequenzen abzustimmen]

Jeder Nutzer hat eine unterschiedliche Kapazität für die Frequenzen, die über Anode und Kathode in

den Körper übertragen werden. Daher enthält das Instrument einen Drehknopf, mit dem jeder Nutzer die für diese Übertragung benötigte Leistung vollständig steuern kann. Mit diesem Ausdruck ist gemeint, dass die Fähigkeit jedes Menschen je nach Frequenzstärke variiert, was manchmal ein Kribbeln auslöst, das man fälschlicherweise für einen Stromschlag hält, wie bei der Stromübertragung. Dies ist eine Überschallübertragung, bei der Elektrizität in den Körper geleitet wird und Schmerzen verursacht, aber im Fall dieser Frequenzen handelt es sich um eine Schwingung und keine elektrische Energie, wie man sie bei der Nutzung von Elektrizität vorstellt; daher werden diese Schwingungen fälschlicherweise akzeptiert, wenn der Nutzer mit diesem Thema nicht so vertraut ist, wie er sein sollte, um den Gebrauch zu verstehen. Wir raten dem Nutzer, definitiv zu verstehen, wie eine Frequenz sicher durch den Körper übertragen werden kann, ohne dass Zellen, Blut, Knochen, Nerven, Muskeln, Sehvermögen, Geschlechtsorgane usw. negativ betroffen sind. Diese Verständlichkeit ermöglicht es dem Nutzer, diese Frequenzen ohne Angst auf sich selbst zu lenken, was ebenfalls ein Ursache oder die Symptome der Krankheit ist, von der er sich gerade befreit hat. Das lässt ihn glauben, dass das Instrument den Erreger der Krankheit nicht devitalisiert hat, obwohl er verschwunden ist; die Angst, dass er das chemische Gleichgewicht seines Körpers aus dem Gleichgewicht gebracht hatte, und die Symptome blieben weiterhin eine falsche Wahrheit gegenüber der wahren Ursache. [Das Instrument, von dem John Marsh in der obigen Aussage spricht, verwendete keinen RF-

(Funkfrequenz-)Träger. Wenn eine HF-Trägerfrequenz verwendet wird, wird die Person, die Anode und Kathode (oder Metall-Handzylinder) hält, nichts wahrnehmen]

Die Zeit, die für jede Frequenz benötigt wird, um den Erreger einer bestimmten Krankheit zu devitalisieren, beträgt immer mindestens 3 Minuten, wenn der Abstand zwischen Anode und Kathode 9 Zoll nicht überschreitet. Wenn jedoch der Abstand zwischen Anode und Kathode 9 Zoll überschreitet, müssen diese Frequenzen jeweils mit 5 Minuten übertragen werden. Das Zeitelement wird entsprechend der für diesen Devitalisierungsprozess benötigten Entfernung bestimmt. Dies wird vom Nutzer bestimmt, in welchem Bereich die Krankheit devitalisiert wird.

**Der Hals:** Die meisten Erkrankungen, die den Hals betreffen, sind: Tuberkulose, Mandelentzündung, pustelartige Akne, Kehlkopfentzündung, Dermatitis, Erkältungen, Beulen, Staphylokokken, Zysten, Grippe, Lymphknoten, Muskelsteifheit, Karzinom, Sarkom und viele andere. Diese Krankheiten werden am besten durch dasselbe System wie bei Kopfkrankheiten beseitigt, einschließlich der Verwendung oder des Diagramms für die jeweilige Krankheit, der elektronischen Betroffenheit, der Länge jedes Frequenzzeitelements und den Tagen dazwischen.

**Die Truhe:** Die Krankheiten, die diesen Bereich betreffen, sind allgemein bekannt als: pustelartige Akne, Erkältungen, Zysten, Bronchitis, Asthma, Bronchialpneumonie, Lungenentzündung, Doppellungenentzündung, Tuberkulose, Karzinom,

Sarkom, Lymphknoten, Dermatitis, Staphylokokken, Beulen, Bursitis, Arthritis, Arten von Herzkrankheiten, Talfieber, Typhus, Grippe, kongestive Lungenerkrankungen und viele weitere können mit demselben oben beschriebenen System eliminiert werden. Ich benutze das Diagramm für das Zeitelement.

**Magen-, Leber- und Darmbereich:** Häufige bekannte Erkrankungen dieser Bereiche sind bekannt als: Kolitis, Darmdarm, Magenulcera, Magenerkrankungen, gelber Gelbsucht, Leberveränderungen, Gallenblasenentzündung, Karzinom all dieser Gebiete, Sarkom, Übelkeit, Lymphdrüsenblockaden, Tuberkulose, Herpesvirus und viele andere. Das gleiche Frequenzübertragungssystem wird in diesen Gebieten wie zuvor beschrieben verwendet. Sieh dir die Zeittabelle an.

**Beckenbereich:** Die meisten Krankheiten, die diesen Bereich betreffen, sind wie folgt: Zysten, Harnröhrenentzündung, Blasenentzündung, Prostataentzündung, Zystitis, Pilz der weiblichen Organe, rektale Erkrankungen wie Hämorrhoiden, Fisteln, Staphylokokken des rektalen Bereichs, Hodensackkrankungen, Infektionen des linken und rechten Eierstocks, Menstruationsunregelmäßigkeiten, Niereninfektionen und chronische Blinddarmentzündungen.

## **TERMINOLOGIEWÖRTERBUCH**

John Marshs Terminologiewörterbuch wird zuerst genannt, damit der Leser die verschiedenen Begriffe, die in diesem von ihm verfassten Artikel verwendet werden, besser versteht.

**VERSTÄRKER:** Zu verstärken bedeutet, zu vergrößern oder mit Kraft zu expandieren. Ein Gerät zur Vergrößerung von Wellen oder Schall. Der Verstärker im Rife-Frequenzinstrument dehnt die Welle der elektronischen Emission aus, sodass sie auf einem Funkband (HF-Trägerfrequenz) in den betroffenen Bereich reist.

**ANODE:** Der positive Pol oder die Elektrode (Metall-Handzylinder) eines Geräts. Es ist die positive Elektrode, zu der die negativen Ionen wandern.

**AUDIBLE:** Das kann gehört werden; für das Ohr wahrnehmbar; laut genug, um gehört zu werden.

**AUDIOFREQUENZ:** Jede Frequenz, die einer normalerweise hörbaren Schallwelle entspricht.

**BLUTTRANSFUSION:** Die Übertragung von Blut von einer Person auf eine andere.

**KALIBRIEREN:** Um sich an die Tonleiter anzupassen oder ein abgestuftes Instrument zu standardisieren. Um in der Regel im Vergleich zu einem Standard festzustellen, an welchen Orten die Abschlüsse im Maßstab platziert werden sollten. Um einer Reihe von Werten der Größe zu entsprechen, die ein Instrument (wie das Rife-Frequenzinstrument) messen soll.

**TRÄGERWELLE:** Eine Radiofrequenz, die verwendet wird, um eine niedrigere Frequenz, meist im Audiobereich, durch den Raum zu übertragen.

**KATHODE:** In einer Elektronenröhre eine Elektrode, durch die ein primärer Strom von Elektronen in den inneren Elektrodenraum eintritt. Im Wesentlichen wird sie allgemein als negative Elektrode (Metall-Handzylinder) bezeichnet.

**URSACHEN:** Die Chemikalien, Säuren oder Mikroorganismen (Viren, Pilze, Bakterien), die die Ursachen von Krankheiten sind.

**KONSTITUENT:** Bestehend oder existierend als wesentliche Komponente oder Zutat; Formen, Komponieren oder Schaffen als wesentlichen Teil; Komponente; Grundschule; Denn Sauerstoff und Wasserstoff sind die "Bestandteile" von Wasser.

**KOORDINATION:** Um das eine mit dem anderen zu koordinieren. Zum Beispiel bei der Verwendung des Rife-Frequenzinstruments, bei dem die ausgestrahlte Frequenzwelle oder Resonanz mit der chemischen negativen Leistung des Organismus koordiniert wurde, um sie mit einer koordinativen Resonanz zu zerstören.

**KULTUREN:** Die Vermehrung von Mikroorganismen oder lebenden Gewebezellen in einem speziellen Medium, das ihr Wachstum fördert.

**DEVITALISIERUNG:** Der Akt der Entvitalisierung oder der Zustand der Entvitalisierung.

**BELEBUNG:** Vitalität oder die Kraft zur Aufrechterhaltung zu berauben: zu zerstören, zu eliminieren.

**ELEKTRONENÜBERTRAGUNG:** Der Prozess wird bei der Übertragung eines Lichtmediums angewendet, das auf eine Radiowelle fällt. Die Übertragung eines Signals oder einer Frequenz eines elektromagnetischen Druckfeldes. Schall und Licht sind zufällig mit einem Elektron als treibende Kraft oder Teilchen und als komplexes Segment des Atomkerns verbunden.

**ELEKTROSTATISCHE ENERGIE:** Eine Menge statischer Elektrizität (oder Elektrizität im Ruhezustand im Unterschied zu einem elektrischen Strom), die auf einer elektrifizierten Oberfläche eines Isoliermaterials oder Leiters vorhanden ist. Besser bekannt als blockierter Strom, der anders als normaler Strom durch Ströme gesteuert wird.

**ELEKTRON:** Eines der kleinsten bekannten Teilchen mit elektrischer Ladung. Seine Ladung kann je nach Position im Atom entweder positiv oder negativ sein. "Negative" Elektronen befinden sich im Teil des Atoms außerhalb des Kerns. "Positive" Elektronen befinden sich im Kern. Es sind die positiven" Elektronen (oder "Positronen"), die von den Rife-Frequenzinstrumenten ausgesandt werden, die als devitalisierendes Mittel die Mikroorganismen zerstören (die die Krankheitserreger im menschlichen Körper sind).

**FREQUENZ:** Zeitabstand zwischen den Emissionen. Ein Beispiel: die Schwingungsfrequenz

in einer Sekunde, um einen bestimmten Ton zu erzeugen.

**FREQUENZBAND:** Ein durchgehender Frequenzbereich, der sich zwischen zwei Grenzfrequenzen erstreckt.

**FREQUENZZÄHLER:** Ein Instrument zur Zählung der vom Gerät abgegebenen Emissionen auf eine bestimmte Frequenz in Koordination mit der von den chemischen Bestandteilen des Mikroorganismus emittierten Frequenz.

**PILZ:** Eine Wucherung am Körper (die einem Pilz ähnelt – Pilz bedeutet: jeder aus einer Klasse pflanzlicher Organismen mit niedriger Entwicklung, einschließlich Pilzen, Krötenpilzen, Schimmelpilzen usw.). Eine schwammige Masse aus morbidem Granulationsgewebe.

**HARMONISCHE TÖDLICHE OSZILLATORISCHE RATE:** ein Band oder eine Welle der Frequenzresonanz, die mit einer Geschwindigkeit schwingt (vibriert), die mit der Resonanz des Lebens eines bestimmten Mikroorganismus koordiniert oder identisch ist. (Die Resonanz des Instruments zerstört den Mikroorganismus, da diese Frequenzwelle (oder Resonanz), die vom Instrument ausgestrahlt wird, von "positiver" Natur ist und die koordinative Resonanz des Mikroorganismus von "negativer" Natur.

**INTRAVENÖS:** Befindet sich in der Vene oder den Venen.

**MALIGNANT:** eine Tendenz, von schlecht zu schlimmer zu werden, virulent, also das Ausmaß

der Pathogenität eines Mikroorganismus, angezeigt durch die Fallsterblichkeit und/oder seine Fähigkeit, das Gewebe des Wirts oder benachbarter Gewebe zu besetzen.

**MEDIEN:** Eine Vielzahl von Mineralien und Kombinationen von Materialien, die für die Kultivierung von Mikroorganismen verwendet werden.

**STOFFWECHSEL:** Sich umdrehen, verändern, verändern. Die Summe aller physikalischen und chemischen Prozesse, durch die lebendige organisierte Substanz produziert und aufrechterhalten wird, wie beim Katabolismus von Zellen.

**KERN:** Zentraler Teil eines Körpers; oder über das, worüber die Materie gesammelt wird.

**OSZILLATORISCHE RATE:** Die Geschwindigkeit, mit der sich die Frequenz- oder Resonanzwellen ausbreiten.

**PATHOGEN:** Das verursacht Krankheiten oder morbide Symptome.

**POSITRON:** Ein Kernteilchen, das sich im Atomkern befindet, hat die gleiche Masse wie ein Elektron und eine positive Ladung, die der negativen Ladung eines Elektrons entspricht. Das Rife-Frequenzinstrument ist das einzige bekannte System der Positronenemission unter kontrollierten Messungen. "Positron" ist ein Synonym für "positives Elektron".

**POSITIVES ELEKTRON:** Siehe POSITRON.

**PRÄNATAL:** Existierend oder vor der Geburt.

**SONDE:** Ein Resonanzleiter, der in einem Wellenleiter oder Hohlraumresonator eingesetzt wird, um elektromagnetische Energie einzufügen oder abzuziehen.

**FUNKWELLE:** Eine elektromagnetische Welle, die im Radio verwendet wird. Genauer gesagt wird eine solche Welle im Funkbetrieb verwendet, außer im Radar oder Fernsehen.

**RESONANZ:** Schwingungen, die mit größerer Amplitude bei einer Frequenz schwingen, wodurch sie resoniert. Wenn man zum Beispiel eine Stimmgabel mit einer "C"-Tonhöhe an einem Ende des Raumes resonieren lässt, erzeugt sie beim Schlagen die Resonanz einer anderen Stimmgabel mit "C"-Tonhöhe am anderen Ende des Raumes.

**SCHALLWELLE:** Eine Veränderung von Druck, Spannung, Teilchenverschiebung, Teilchengeschwindigkeit, die in einem elastischen Material ausgebreitet wird.

**RAUMLADUNG:** Die netto elektrische Ladung innerhalb eines gegebenen Volumens. Eine negative Ladung in einer Vakuumröhre, die durch Elektronen entsteht, die von der Kathode emittiert, aber nicht sofort zur Anode gezogen werden, und bleibt somit im Raum zwischen Anode und Kathode erhalten.

**SUPERSUBSONISCHES BAND:** Super bedeutet intensive Kraft. Subsonisch bedeutet unten, unten, unter, Band bedeutet Welle, Reisegeschwindigkeit. Das Supersubschallband bedeutet eine

Geschwindigkeit, die niedriger ist als die Schallgeschwindigkeit; bedeutet "Infraschall" – eine Frequenz, die unterhalb der Schallgeschwindigkeit liegt. Das Wort Infraschall kann als Modifikator verwendet werden, um Infraschallfrequenzen zu bezeichnen oder sich auf sie zu beziehen. Allgemein als Unterschallfrequenz bezeichnet.

**TOXIN:** In der Medizin gilt jedes giftige Albumin, das durch bakterielle Wirkung produziert wird. Die bakteriellen Proteine widerstehen der hohen Temperatur und scheinen bei allen Bakterien die gleichen Eigenschaften zu haben, verursachen nicht spezifische Infektionen, sondern alle gleichermaßen Fieber, Entzündungen und Eiterung; Tuberkulin ist ein Beispiel.

**ÜBERTRAGUNG:** Die Energieübertragung vom Sender zum Empfänger.

**TUMOR:** Schwellung, morbide Vergrößerung, ein Neoplasma, eine Masse neuen Gewebes, die unabhängig von ihren umgebenden Strukturen erhalten bleibt und wächst und keinen physiologischen Zweck hat.

Der Rest dieses Artikels enthielt die Frequenzen, die für die verschiedenen Krankheitserreger verwendet wurden, sowie einen Bericht über die Elektronentherapie. Um diesen Bericht zu lesen und alle Frequenzen zu erfahren, die von Dr. Rifas Maschinen verwendet wurden, klicken Sie auf die untenstehenden Links.

# Dr. Rifés wahre ursprüngliche Frequenzen

## Rife-Maschinen und Elektronentherapie

ZWEITER ARTIKEL.

### **Behandlungen mit elektromagnetischen Kraftfeldern.**

(1). Die Diagnose wird entweder bei Menschen oder Tieren gestellt. Die Anamnese des Patienten wird überprüft. Die Unterlagen werden vorbereitet, damit der Patient mit elektromagnetischen Kraftfeldinstrumenten die Behandlungen beginnen kann. Die Behandlung beginnt dort, wo der Patient zu diesem Zeitpunkt steht. Ein Wort der Warnung: Wenn dieser Patient kürzlich radioaktiv behandelt oder expositioniert wurde, hat sich dies als etwas erwiesen, dass die Entvitalisierungsprozesse gehemmt werden. Die Auswirkungen der Radioaktivität müssen zunächst nachlassen, damit ein gültiges Ergebnis erzielt werden kann. Radioaktive Teilchen haben ultrahohe Frequenzen, elektromagnetische Energie liegt im Subaudiobereich von 20 bis 20.000 Zyklen pro Sekunde. Das eine kann das andere ausgleichen und den Prozess untergraben. Unabhängig davon, ob der Patient radioaktive [Strahlung] behandelt wurde oder nicht, schadet der Einsatz elektromagnetischer Behandlungen weder dem Menschen noch dem Tier.

(2). Wenn das kleine Gerät verwendet wird und eine diagnostizierte Krankheit am oberen

Oberschenkel festgestellt wird, wird die AOD-Sonde auf einer Seite des erkrankten Bereichs platziert, die CATHODE-Sonde auf der gegenüberliegenden Seite direkt gegenüber der ANODE und das Bein wird zum Kondensator oder Teil des Instruments. Der Regler des Instruments stimmt auf das Bein die richtigen Frequenzen ein, um den Mikroorganismus zu zerstören, der der Erreger dieser Krankheit ist. Diese Sonden müssen jederzeit unbedecktes Fleisch berühren, um das beste Ergebnis zu erzielen, ohne Stoff, Haare usw. Die Minuten, die diese Behandlung benötigt, hängt vom Abstand zwischen ANODE und KATHODE ab. Bei weniger als 9 Zoll wird auf jeder Frequenz eine dreiminütige Zeit in das infizierte Gebiet übertragen, bei mehr als 9 Zoll werden für jede Frequenz 5 Minuten gesendet. Der Leistungsausgabe-Regler regelt den Komfort oder das Unbehagen des Übertragungsprozesses für den Patienten. Die Behandlungen mit diesem kleineren Instrument können gemäß der folgenden Tabelle für die ungefähr behandelte Krankheit wiederholt werden.

(3). Das große Instrument ist leistungsfähiger, da es ein R/F-Radiofrequenzsender oder Rundfunksender ist. Es bewirkt dasselbe wie das kleinere Instrument, hat aber einen tieferen Durchschlagseffekt. Bei inneren Erkrankungen wird dieses Instrument meist eingesetzt. Es muss das Tier oder den Patienten nicht berühren. Für Tiere ist es viel besser, weil man sie nicht berührt. Sie werden ängstlich, verstehen nicht. Für die diagnostizierten Krankheiten gelten die gleichen Fristen. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen ungefähr den Zeit- und Intervallplan für jede Krankheit.

## **VI. DIE INSTRUMENTE und deren Verwendung erfolgen; ZWEI ARTEN.**

(A). Typ Nummer eins. Das kleinere Instrument, tragbar, Frequenzsignalgenerator, der über zwei Sonden [Metallhandzylinder] Frequenzen bestimmter Zahlen auf einer Trägerwelle und Wellenform überträgt. Hat zwei Anschlüsse, einen für Sonde Nr. 1, eine ANODE, und eine für Sonde Nr. 2, eine Kathode. Jede dieser Sonden besteht aus Metallplatten, die an undichte Kabel von 1,80 Metern Länge befestigt sind. Zwischen diesen beiden Sonden wird durch die Leistungseinheit des Instruments ein elektromagnetisches "Feld" erzeugt.

Ref. I-(A), 1 und 2 dieses Dokuments.

(1). Bei der Nutzung dieses Geräts ist es am besten, es vor der tatsächlichen Nutzung 15 Minuten zu erwärmen. Der infizierte Teil soll so direkt wie möglich zwischen diesen beiden Sonden platziert werden. Es ist unerlässlich, sie niemals gegen Kleidung oder Haar als vollständige Kontaktlinse zu verwenden. Wenn Sie die Übertragungskraft auf eine Stelle auf dem Fleisch anwenden, verwenden Sie den Ausgangsknopf, um die Leistung einzustellen und dem Patienten ein angenehmes Gefühl zu geben. Ein leichtes Kribbeln tritt auf, dann dreht man es zurück, sodass der Patient es gerade noch spürt. Das Kribbeln ist die Resonanz der Frequenzen, die in und durch diesen Bereich des Körpers übertragen werden. Schau dir die Übersicht nach Behandlungsdaten an, wie viele Frequenzen, wie oft usw. Dieses Gerät deckt die meisten äußeren und einige nahegelegenen

Innenbereiche ab. Hilfreich für beide und harmlos ohne Nachwirkungen. Bei der Handhabung dieses empfindlichen Instruments sollte jederzeit Vorsicht geboten werden, um es in perfektem und kalibriertem Zustand zu halten. Nicht anstoßen, rütteln oder fallen lassen. Falls dies geschieht, ist eine Neukalibrierung erforderlich. Es ist sicher, egal ob kalibriert oder nicht, aber nutzlos, wenn es nicht kalibriert ist.

(B). Typ Nummer zwei. Dieses größere Instrument ist außerdem ein Signalfrequenzgenerator R/F (Radiofrequenz) Sendertyp. Übertragung dieser Frequenzen auf einer Trägerwelle und Wellenform über eine Antenne. Das ist kein "physischer Kontakttyp" wie der oben. **Diese ist ebenfalls tragbar, schwerer und genau gesteuert wie die oben, jedoch erfolgt die Übertragung aus einer Entfernung von 12 bis 24 Zoll von der Antenne zum behandelten Bereich.** Dieses Instrument wird bei Tieren anstelle des oben genannten kleineren Geräts verwendet. Das Berühren von Tieren macht ihnen Angst. Die Kraft dieses Instruments ist größer und tiefer durchdringt. Keine schädlichen Auswirkungen auf Menschen und/oder Tiere und keine Nachwirkungen wurden dokumentiert. Siehe Art der Krankheiten und Zeitplan in der Tabelle in diesem Dokument, Bereich "V". Die gleiche Sorgfalt bei diesem Gerät wie bei dem oben genannten kleineren Gerät.

## **VII. KONTROLLIERTE LABORFORSCHUNG**

(A). Mehrere effektive Forschungsprogramme sollten in die Tat umgesetzt werden.

(1) Die Verwendung von Kulturen, Petrischalen, wobei das kleinere Instrument für diesen Zweck verwendet wird, wobei Sonden in den Agar-Jell eingeführt werden, bevor er aushärtet und bevor die Kulturen wachsen. Nachdem diese Kulturen für die Tests bereit sind, zählen Sie die Sporen, falls es sich um Pilze oder Bakterien handelt. Sonden werden an das für dieses Experiment voreingestellte Kabel an das Instrument angeschlossen, sodass der Bediener des Instruments die tödlichen Frequenzen in die Kultur einstellen kann. Richten Sie dieses Experiment unter dem Mikroskop ein und lassen Sie einen Bakteriologen die Wirkung des elektromagnetischen Kraftfeldes auf die Kulturen beobachten, sehen Sie die Ergebnisse sofort. Wenn Veränderungen festgestellt werden, nehmen Sie die Petrischale mit der Kultur unter dem Mikroskop heraus und kehren Sie zum Inkubator zurück, um zu sehen, ob Kulturen nachwachsen oder neu kultiviert werden können. Wenn nicht, wiederholen Sie diesen Prozess oft genug, um sich von der Wirksamkeit dieser Form der Entvitalisierung zu überzeugen. Protokollieren Sie alle Abläufe und Daten. Alle Daten werden für die zukünftige Nutzung wertvoll sein.

(2). Der Einsatz des großen Instruments mit der Senderantenne kann in diesem nächsten Schritt genutzt werden, um die Wirksamkeit zu qualifizieren. Verwenden Sie für diesen Test so viele weiße Ratten, wie Sie benötigen. Sprague-Dawley-Ratten werden empfohlen, vielleicht

Säugler. Sie sollen mit Dosen von Rattenleukämie-Vollblut injiziert werden. Nehmen wir eine Gruppe, die injiziert wurde, und dieselbe Anzahl in der anderen Gruppe, die nicht injiziert wurde. Eine weitere Gruppe injizierter Ratten, aber nicht zu behandeln. Diese dienen als Kontrollen. Die injizierten Ratten, die behandelt werden sollen, und die nicht injizierten Ratten werden ebenfalls behandelt, aber eine Gruppe von Ratten soll injiziert, aber nicht behandelt werden. Die Aufzeichnungen zeigen, wann die injizierten, aber nicht behandelten Ratten sterben sollten. Die behandelten sollten die unbehandelten, die injizierten überleben. Eine Reihe dieser Tests sollte durchgeführt werden, um die Wirksamkeit dieser Form des elektromagnetischen Kraftfeldes bei dieser Art von Krankheit zu belegen. Mach so viele Tests, wie es die Ergebnisse gibt. Es sollten sorgfältig Aufzeichnungen über all diese Tests, Zeitpunkte, Anzahl der durchgeführten Behandlungen usw. geführt werden. Auch die Pflege dieser Ratten ist bei der Prüfung von entscheidender Bedeutung. Auch die Beseitigung von Angst vor den Ratten ist entscheidend.

(3). Der Einsatz beider Instrumente bei menschlichen Patienten wäre der nächstbeste Test für ihre Wirksamkeit. Bei äußeren Infektionen können sowohl das kleinere als auch das große Instrument verwendet werden. Das kleinere Instrument für Dermatose, kleine Infektionsstellen, Fußpilz, Pilze, Beulen und Ähnliches. Das größere Instrument deckt ein größeres Gebiet und die tieferen infizierten Bereiche ab. Vollständige Anamnese dieser menschlichen Labortests sollte für weitere Forschung dokumentiert werden. Die

Behandlung vieler kleinerer Krankheiten mit dem kleineren Gerät zeigt die Wirksamkeit seiner elektromagnetischen Leistung. Eine sorgfältige, kontrollierte Diagnose jeder Erkrankung durch einen qualifizierten Arzt vor und nach jedem Test ist vorgeschrieben und sowohl bei Menschen als auch bei Tieren dokumentiert. Objektträgerschnitte wurden erstellt, Biopsien entnommen und jede behandelte Untersuchung mikroskopisch analysiert, um diese Form der elektromagnetischen Behandlung zu dokumentieren. Prüfen Sie in allen Fällen auf Nachwirkungen dieser Behandlungsform, um positive Ergebnisse zu gewährleisten.

**Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die injizierten Ratten von allen behandelten Ratten isolieren, da diese Radiowellen eine weite Entfernung vom Behandlungsgebiet ausbreiten können. Ich würde empfehlen, nicht weniger als 25 Meter oder mehr von den restlichen behandelten Stellen entfernt zu sein. Die Ratten, die zur Kontrolle injiziert werden, sollten aus Sicherheitsgründen bei Tests nicht mit den Behandlungen der anderen Gruppen in Kontakt kommen. In diesem Bereich sollte viel Sorgfalt geboten werden.**

(4). Der Direktor des Labors, das diese Experimente und Tests durchführt, sollte die Injektion der Ratten, die zu behandelnde Zeit, die Art der Injektion und die Anzahl der durchzuführenden Tests bestimmen. Der Bediener des Instruments sollte das Signal erhalten, damit seine Arbeit an diesen Ratten beginnen soll, genaue Zeit, eine Person, die alle Aktivitäten,

verwendete Geräte, Rattentyp, Zeitpunkt jeder Behandlung und Ergebnisse jeder durchgeführten Untersuchung, Personen, Labortechniker, Hilfsmittel usw. dokumentiert. Anschließend sollte eine sorgfältige Untersuchung der Endergebnisse durchgeführt und aufgelistet werden. All dies wird die Wirksamkeit dieser Form der physikalischen Medizin bestimmen, und weitere Pläne für die zukünftige Nutzung dieser Instrumente können gemacht werden.

**[Klicken Sie hier, um das Originaldokument zu sehen.](#)**