RIFEVIDEOS.COM

Ihre Rife Machine History Bildungs-Website.

Dr. Rife's wahre Originalfrequenzen

Dr. Rife und Philip Hoyland
mit einer 1938 Beam Ray Machine

Eine originale 1938-39 Beam Ray Machine, die 2008 gefunden wurde

Dr. Rifes ursprüngliche Frequenzen

Die Frequenzen, die Sie auf dieser Seite finden, sind die Frequenzen, die Sie kennen müssen, wenn Sie einen Frequenzgenerator kaufen möchten. Die wahren Originalfrequenzen von Dr. Rife, die auf dieser Seite gefunden wurden, basieren nicht auf Vermutungen, sondern auf harten Beweisen, die aus allen bekannten Rife-Dokumenten und der tatsächlichen Analyse von drei originalen Rife-Maschinen, die gefunden wurden, gesammelt wurden. Interessant ist, dass die

Frequenzen bei allen Instrumenten gleich geblieben sind. Es war nur die Art und Weise, wie die Frequenzen erzeugt wurden, die sich vom Rife Ray #4 zum Rife Ray #5 änderte. Nachdem Sie diese Seite gelesen haben, sollten Sie die Seite "Dr. Rife und Philip Hoyland's 3.30 MHz Sweep" lesen.

Unten, im ersten Diagramm aufgeführt, sind Dr. Rifes hohe HF-Frequenzen von 1936 aufgeführt, die mit Philip Hoylands Seitenbandmethode zur Erzeugung von Dr. Rifes ursprünglichen Frequenzen berechnet wurden. Es enthält die genauesten Primärfrequenzen von Dr. Rifes wahren Frequenzen oder M.O.R.S, die von einer Replik einer der originalen Rife Ray #5 oder Beam Ray Clinical Maschinen stammen, die 1938 für die Beam Ray Corporation gebaut wurden. Der Begriff M.O.R. steht für "Mortal Oscillatory Rate" oder die Frequenz, die den schädlichen Mikroorganismus devitalisiert, abtötet oder unschädlich macht.

Dr. Rife's Original High RF Frequencies Fine Tuned To The Precise Frequencies By Philip Hoyland In 1936.	
Actinomycosis (Streptothrix)	191,803 Hz
Anthrax	139,200 Hz
B. Coli (Rod form)	416,510 Hz
B. Coli (Filterable virus)	769,035 Hz
Bacillus X or BX (Cancer Carcinoma)	1,607,450 Hz
Bacillus Y or BY (Cancer Sarcoma)	1,529,520 Hz
Gonorrhea	233,000 Hz
Spinal Meningitis	426,862 Hz
Staphylococcus Pyogenes Aureus	477,660 Hz
Staphylococcus Pyogenes Albus	549,070 Hz
Streptococcus Pyogenes	719,150 Hz
Syphilis	788,700 Hz
Tetanus	234,000 Hz
Tuberculosis (Rod)	369,433 Hz
Tuberculosis (Virus)	769,000 Hz
Typhoid Fever (Rod)	759,450 Hz
Typhoid Fever (Virus)	1,445,180 Hz

www.rifevideos.com

WEATHER FORECAST

Yesterday's Low and High

THE ASSOCIATED PRESS — THE INTERNATIONAL NEWS

EVENING TRIBUNE

FINAL HOME

No. 13873 — 28 PAGES — 2 SECTIONS — SAN DIEGO, CALIFORNIA, FRIDAY, MAY 6, 1938 — SECTION A — FIVE CENTS — 75c PER MONTH

'Klan' Threat To Filipino Guardsmen

MIAMI, Fla., May 6 (A.P.)—Comdr. C. H. Abel, of the United States coast guard, demanded police protection today for two Filipino guardsmen threatened—purportedly by the Ku Klux Klan — because of their marriage to white women.

Good Records Cited

Saying the Filipinos, Francisco Rufin and Pedro Arpin, had good service records and were law-abiding citizens, the commander of the cutter Mojave declared it was "up to the local authorities to give them protection against the Klan or any other organization which attempts such illegal terrorist activities."

"If the local police cannot or will not afford them this protection," he added, "I will take steps to see that they get it."

Police Chief H. Leslie Quigg said the coast guardsmen would receive protection, but that no guard would be stationed at their homes.

The Filipinos said a delegation of eight men called at the home where both couples live last night and handed Mrs. Rufin a note crudely printed in crayon on a telegraph blank which read, "we are tired of white women living with Filipinos. This is a warning for you to move within 24 hours. Signed—Ku Klux Klan."

Rufin said today he would obey the warning and move "as quickly as I can" but that he would not be able to do so by the deadline tonight.

Boost in Cost Of S. D. Relief

San Diego's needy during the 10-month fiscal year ending July 1 will require $4,116,111 in relief, of which all but $1,253,404 will be furnished by state and federal governments, a budget drafted last night by the county welfare board estimated. The estimated welfare expenditures are believed the largest in the county of the county.

Taxpayers have during the current 1937-38 fiscal year, to end June 30, have paid in property taxes $1,252,584

DRY SEASON ON; FIRE OFFICIALS URGE PRECAUTION

With the warm weather season officially opened and expected to continue throughout the summer, fire department officials warned today that the danger months lie just ahead and urged citizens to take extra precautionary measures to prevent destructive blazes.

Due to the drying-out action of the summer sun, the mild-year months always are productive of fire hazards not present in winter, it was pointed out. Citizens are urged to use care in disposing of matches, lighted cigarettes and other dangerous articles.

Two small rubbish and grass fires were reported last night, but no property damage resulted, it was reported.

Deal Is Raked By Hoover as 'Dictatorship'

OKLAHOMA CITY, May 6 (U.N.S.)—Former President Herbert Hoover today left the state Republican convention here with 11 demands on the national government to save this country from the "dangerous road to dictatorship."

Hoover raked the Roosevelt administration for causing the present business recession, and drew a parallel between new deal policies and

(Text of Hoover speech on Page 6-A.)

the course taken by authoritarian countries of Europe. Already, he said, "it would startle the people to have a detailed list of the powers over their daily life they have surrendered to the president and his bureaucrats."

None of the European nations he said, started out to surrender itself to a dictator.

"Its variable doctrine," he continued, "has undoubtedly could and cur-

(Continued on Page 4, Col. 6)

'WON'T RUN IN '40,' ROOSEVELT QUOTED IN PARIS PAPER

PARIS, May 6 (U.N.S.)—It will

House Forces Vote on Wage-Hour Bill

DREAD DISEASE GERMS DESTROYED BY RAYS, CLAIM OF S. D. SCIENTIST

Petition O. K.'d In Scramble By Solons

WASHINGTON, May 6 (A.P.)—House members completed a petition today to force house consideration of the revised wage-hour bill.

Rules Group Relieved

The 218th signature was affixed half than three hours after the petition was filed.

Rep. Sirovich (D-Ala.) was the 218th signer.

Signatures of a majority of the all members of the house are required to petition discharging house committee from consideration of bills.

Consideration of the wage-hour petition releases the rules committee from jurisdiction in the measure and has the effect of bringing the revised wage-hour bill to the house floor for consideration within five months.

On several occasions, the members attempting to affix their signatures threatened to tear the paper apart.

Speaker Bankhead, rapping vainly for order, was forced to suspend proceedings.

Apparatus of San Diegan Seen as Boon to Medical World

Royal Raymond Rife, left, [illegible] with the Rife ray apparatus

Cancer Blow Seen After 18-Year Toil by Rife

By NEWELL JONES

Copyright, 1938, by The Evening Tribune

Discovery that disease organisms, including one occuring in dread cancer, can be killed by bombarding them with radio waves tuned to a particular length for each kind of organism, was claimed today by a San Diego scientist, Royal Raymond Rife, Pt. Loma. He added that he had isolated this cancer organism but is not positive yet that it is the direct cause of the disease.

The discovery promised fulfillment of man's age-old hope for a specific destroyer of all his infectious diseases, although Rife carried any claim that he had established this yet. He announced his work in the conservative manner of scientists, but Dr. Virgil Jackson said the method consisted in their testing of successful bombardment of thousands of cultures of organisms, including almost all kinds known to afflict mankind.

Organisms from tuberculosis, cancer, sarcoma, the tumor resembling cancer but not so mortal as it, deadly streptococcus infection, typhoid fever, staphylococcus infection and two forms of leprosy were among many which the scientist reported are killed by the waves. He said that his laboratory experiments indicated that the method could be used successfully against

Das Rife Ray #5 oder Beam Ray Clinical Instrument, das oben in der Zeitung vom 5. Mai 1938 abgebildet ist, wurde im Sommer 1936 von Philip Hoyland, dem Ingenieur von Dr. Rife, entworfen und gebaut. Diese Maschine ging im Frühjahr 1938 mit der Gründung der Beam Ray Corporation in die volle Produktion. Die neue Beam Ray Clinical-Maschine war die einzige Rife-Maschine, die jemals an Ärzte verkauft wurde. Die neue Beam Ray Clinical-Maschine verwendete auch eine neue Methode, die von Philip Hoyland entwickelt wurde und die hohen HF-Frequenzen von Dr. Rife durch die Verwendung einer Low-Q-Schaltung erzeugte, die hohe HF-Oberwellen-Seitenbandfrequenzen erzeugte. Diese hohen HF-Seitenbandfrequenzen wurden durch die Verwendung einer hohen HF-Trägerfrequenz erzeugt, die mit niedrigen Audiofrequenzen moduliert wurde. Bei den niedrigen Audiofrequenzen handelte es sich nicht um die Behandlungsfrequenzen, sondern um die hohen HF-Seitenband-Behandlungsfrequenzen (RF = Radio Frequency) aus der hohen HF-Trägerfrequenz. Wenn die tiefen Audiofrequenzen, die die Seitenbandfrequenzen erzeugten, mehr als mehrere Hertz oder Frequenzen abweichen würden, würde die Seitenbandmethode nicht funktionieren. Aufgrund dieses Problems stellte Philip Hoyland sicher, dass er die genauesten Audiofrequenzen verwendete, die die Seitenbandfrequenzen, die die Krankheitserreger devitalisierten, in die Mitte ihres Fensters der Verwundbarkeit brachten.

Dr. Rife fand heraus, dass jeder Krankheitserreger einen Frequenzbereich hat, in dem er betroffen sein kann, und das nennen wir sein "Fenster der Verwundbarkeit". Es scheint, dass Philip Hoyland sicherstellen wollte, dass jede Seitenbandfrequenz, die einen Krankheitserreger devitalisieren würde, so nah wie möglich an der Mitte dieses Fensters der Verwundbarkeit liegt. Die

Seitenbandmethode, die Philip Hoyland verwendete, galt 1936 als der neueste Stand der Radiotechnologie, als er diese neue Rife Ray #5 oder Beam Ray Clinical Machine für Dr. Rife entwickelte. Wenn die Leute von der berühmten Klinik aus dem Jahr 1934 hören, in der sich 16 Patienten, einige mit Krebs und andere mit Tuberkulose, erholten, dann waren es diese primären Frequenzen, die verwendet wurden. In der folgenden Tabelle werden Sie feststellen, dass keine der ursprünglichen Frequenzen von Dr. Rife niedrige Audiofrequenzen sind. Seine Frequenzen reichen von 139.200 Hertz für Milzbrand bis zu 1.607.450 Hertz für das BX-Krebsvirus. Dr. Rife verwendete keine niedrigen Audiofrequenzen bei diesen Organismen, um sie zu devitalisieren oder unschädlich zu machen. Die Audiofrequenzen wurden nur verwendet, um die hohen HF-Seitenbandfrequenzen zu erzeugen. Es waren diese hohen HF-Seitenbandfrequenzen, die die Mikroorganismen devitalisierten. Dr. Rife verwendete bei diesen Organismen immer hohe HF (Radiofrequenzen). Um das Originaldokument von 1935 aus Dr. Rifes Labor zu sehen, das die ursprünglichen hohen HF-Primärfrequenzen zeigt, klicken Sie hier.

Unten, in der zweiten Tabelle, sind Dr. Rifes Frequenzen aus dem Jahr 1935 aufgeführt, die in seinen Rife Ray #3 und Rife Ray #4 Rife Machines verwendet wurden. Diese Frequenzen wurden 1935 von Dr. Rife und seinem Ingenieur Philip Hoyland von Dr. Rife's Rife Ray #3 Instrument mit einem Master-Oszillator abgelesen. Diese Frequenzen reichten von 139.200 Hertz für Milzbrand bis 1.604.000 Hertz für das BX-Krebsvirus. Der Grund, warum es einen leichten Unterschied zwischen den Frequenzen des ersten Diagramms gibt, das oben gezeigt wird, und des zweiten Diagramms, das unten gezeigt wird, ist, dass Philip Hoyland, der Ingenieur von Dr. Rife, die Frequenzen im Jahr 1936 fein abgestimmt hat, damit er die genauesten Frequenzen für die Verwendung im neuen Rife Ray #5 oder Beam Ray Clinical Instrument hat.

Dr. Rife's Original Rife Ray #4 High RF Frequencies Read By Philip Hoyland in 1935. All But One Frequency Was Rounded To The Thousandth.	
Actinomycosis (Streptothrix)	192,000 Hz
Anthrax	139,200 Hz
B. Coli (Rod form)	417,000 Hz
B. Coli (Filterable virus)	770,000 Hz
Bacillus X or BX Virus (Cancer Carcinoma)	1,604,000 Hz
Bacillus Y or BY Virus (Cancer Sarcoma) This frequency was not on the Rife Ray #4 document because it was not found at that time. It was in 1936 when this viruses frequency was obtained and it was used in the Beam Ray Clinical machine. We included it here with this explanation.	1,530,000 Hz
Gonorrhea	233,000 Hz
Spinal Meningitis	427,000 Hz
Staphylococcus Pyogenes Aureus	478,000 Hz
Streptococcus Pyogenes	720,000 Hz
Syphilis	789,000 Hz
Tetanus	234,000 Hz
Tuberculosis (Rod)	369,000 Hz
Tuberculosis (Virus)	769,000 Hz
Typhoid Fever (Rod)	760,000 Hz
Typhoid Fever (Virus)	1,445,000 Hz

www.rifevideos.com

Obwohl es den Anschein hat, dass die Frequenzen von 1936 die genaueren Frequenzen sind, sollte jeder, der sich diese beiden Frequenzdiagramme ansieht, verstehen, dass beide Karten die gleichen M.O.R.S darstellen. In der folgenden Tabelle werden Sie feststellen, dass alle bis auf eine dieser Frequenzen auf das nächste Tausendstel gerundet wurden, was darauf hindeutet, dass Philip Hoyland im Jahr 1935 wahrscheinlich nicht mehrere Messungen jeder Frequenz vorgenommen hat. Hätte er mehrere Messungen von jeder Frequenz vorgenommen, wäre diese Liste genauer gewesen, als wenn die Frequenzen auf das nächste Tausendstel gerundet worden wären. Aufgrund des geringfügigen Unterschieds zwischen den Frequenzen in diesen Diagrammen würde jeder, der sie verwendet, beide Frequenzsätze abdecken wollen, indem er von einer Frequenz zur anderen schwenkt, nur um sicherzustellen, dass er die M.O.R.-Frequenz, die er zu treffen versucht, nicht verpasst. Um noch einmal das Originaldokument von 1935 aus Dr. Rifes Labor zu sehen, das die originalen Frequenzen von 1935 zeigt, klicken Sie hier.

Nachdem wir nun verstanden haben, warum sich diese beiden Frequenzdiagramme geringfügig unterscheiden, werden wir uns noch einmal das Diagramm von 1936 ansehen, oder das erste Diagramm auf dieser Seite, das die genaueren hohen HF-Frequenzen enthält. Wie wir bereits erwähnt haben, wurden diese genaueren hohen HF-Frequenzen aus den ursprünglichen Audiofrequenzen gewonnen, die in der Rife Ray #5 oder Beam Ray Clinical-Maschine verwendet

wurden, die die harmonischen Seitenbandfrequenzen erzeugten, die die schädlichen Mikroorganismen devitalisierten.

In der nächsten Tabelle, die unten gezeigt wird, sind die höheren Audiofrequenzen aufgeführt, die von Philip Hoyland in der ursprünglichen Beam Ray Clinical-Maschine verwendet wurden, um durch harmonische Seitenbänder die genaueren hohen HF-Frequenzen zu erzeugen. Wir werden noch einmal darauf hinweisen, dass diese hohen Audiofrequenzen, die in der folgenden Tabelle gezeigt werden, die Frequenzen waren, die verwendet wurden, um die Tabelle von Dr. Rifes hohen HF-Frequenzen von 1936 zu erstellen. Die Leute haben fälschlicherweise diese höheren Audiofrequenzen verwendet, weil sie glaubten, dass es sich um Dr. Rifes ursprüngliche Primärfrequenzen handelte. Sie machten diesen Fehler, weil sie nicht wussten, dass diese hohen Audiofrequenzen mit einer harmonischen Trägerfrequenz von 3,30 Megahertz (3.300.000 Hertz) verwendet werden mussten, um durch harmonische Seitenbänder Dr. Rife ursprüngliche hohe HF-Frequenzen zu erzeugen.

Higher Low Audio Frequencies Incorrectly Believed To Be Dr. Rife's True Frequencies. Must Be Used With 3.30 MHz To Work.			
B or E Coli Rod	8,020 Hz	Syphilis or Treponema	6,600 Hz
B or E Coli Virus	17,220 Hz	Tetanus	1,200 Hz
BX Virus Carcinoma	21,275 Hz	Tuberculosis Rod	8,300 Hz
BY Sarcoma	20,080 Hz	Tuberculosis Virus	16,000 Hz
Pneumonia or Spinal Meningitis	7,660 Hz	Typhoid Rod	6,900 Hz
Staphylococcus	7,270 Hz	Typhoid Virus	18,620 Hz
Streptococcus	8,450 Hz	Worms	2,400 Hz
Streptothrix	7,870 Hz		

www.rifevideos.com

Zum Verständnis des Lesers geben wir eine komprimierte Version darüber, wie es zu diesem Fehler kam. Die Audiofrequenzen, die in den Rife Ray #5 oder Beam Ray Clinical Rife-Maschinen verwendet wurden, kamen zustande, weil der Ingenieur von Dr. Rife, Philip Hoyland, Audiofrequenzen verwendete, um Seitenbänder mit hoher HF-Frequenz zu erzeugen, die höhere Obertöne der ursprünglichen hohen HF-Frequenzen von Dr. Rife erreichten. Es war die hohe HF-Seitenbandfrequenz, die durch die Audiofrequenz erzeugt wurde, die dann den schädlichen Mikroorganismus devitalisieren oder abtöten würde. Philip Hoyland verwendete in diesem Beam Ray Clinical Instrument auch ein neues M.O.P.A. (Master Oscillator Power Amplifier) Schaltungsdesign. Es war dieses neue Schaltungsdesign mit niedriger Güte, das die hohen HF-Seitenbandfrequenzen für jeden Organismus erzeugte.

Bis heute wissen wir, dass Philip Hoyland zwei verschiedene Trägerfrequenzen, 3,30 und 3,80 Megahertz, in seinem Rife Ray #5 oder Beam Ray Clinical Instruments verwendete. Es ist möglich, dass er auch andere Trägerfrequenzen mit anderen von ihm gebauten Maschinen verwendet hat. Unten sehen Sie ein Foto einer anderen Rife Ray #5 oder Beam Ray Clinical Maschine, die

möglicherweise einen anderen Träger als 3,30 oder 3,80 Megahertz verwendet hat.

In einem der originalen Beam Ray Clinical Instrumente von 1938, die wir besprochen haben, verwendete Philip Hoyland eine feste HF-Trägerfrequenz von 3,30 Megahertz in Kombination mit den verschiedenen Audiofrequenzen, die in der obigen Tabelle gezeigt werden. Aber weder die 3,30-Megahertz-Trägerfrequenz noch die Audiofrequenzen werden von sich aus etwas tun. Wenn jedoch die harmonische Trägerfrequenz von 3,30 Megahertz und die niedrigen Audiofrequenzen kombiniert oder moduliert werden, erzeugen sie viele harmonische Seitenbandfrequenzen. Es handelte sich um eine dieser harmonischen Seitenbandfrequenzen, die sich mit einer höheren Harmonischen von Dr. Rifes primärer M.O.R.-Frequenz deckten und den schädlichen Mikroorganismus devitalisierten oder unschädlich machten. In der Spektralanalysegrafik, die von der originalen 1938 Beam Ray Clinical Machine stammt, die 2008 gefunden wurde, können Sie diese Seitenbandfrequenzen sehen, die durch die niedrigen Audiofrequenzen von Philip Hoyland erzeugt werden. Die Trägerfrequenz betrug 3.800 Megahertz und wird durch die höchste Frequenzspitze in der Grafik dargestellt. Bei den Seitenbändern handelt es sich um alle anderen niedrigeren Frequenzspitzen, die in der Grafik angezeigt werden.

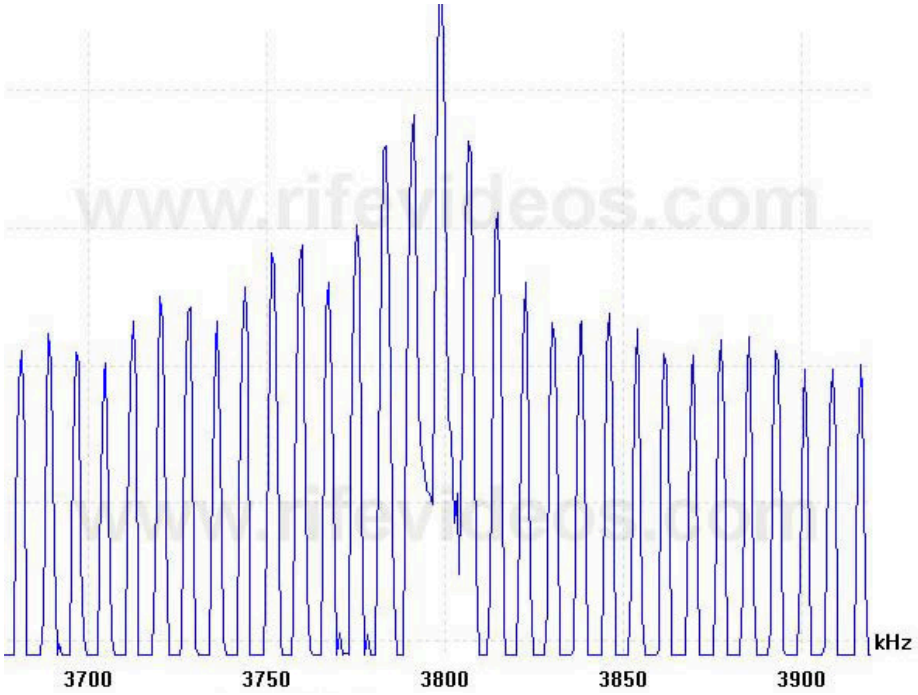

Weil diese Informationen so **WICHTIG** sind, müssen wir diese Tatsache noch einmal betonen, damit niemand, der diese Informationen liest, sie missversteht. Wenn Sie nur die Audiofrequenzen allein verwenden, werden Sie die Frequenzen von Dr. Rife nicht erzeugen. Wenn Sie nur die HF-Trägerfrequenz von 3,30 Megahertz ohne die korrekten Audiofrequenzen verwenden (siehe oben in der Tabelle), werden Sie die Frequenzen von Dr. Rife nicht erzeugen. Die korrekten Audiofrequenzen, die in diesem Instrument verwendet werden, **MÜSSEN** mit einer HF-Trägerfrequenz von 3,30 Megahertz kombiniert werden, sonst sind sie nutzlos und erzeugen keine der hohen HF-Frequenzen von Dr. Rife. Es sind die hohen HF-Seitenbandfrequenzen, die durch die Kombination oder Modulation der Audiofrequenzen und der festen Trägerfrequenz von 3,30 MHz erzeugt werden, die die Mikroorganismen abtöten oder devitalisieren. Da diese Wechselwirkung zwischen den Audiofrequenzen und der HF-Trägerfrequenz von 3,30 Megahertz nicht verstanden wurde, ist dies der Grund, warum das Beam Ray Clinical Replica-Instrument aus den 1950er Jahren, das AZ-58, nicht mit voller Leistungsfähigkeit funktionierte.

Philip Hoyland benutzte diese höheren tiefen Tonfrequenzen, um die wahren Frequenzen von Dr. Rife zu verbergen. Der Grund, warum er Dr. Rifes wahre Frequenzen verbergen musste, ist die Tatsache, dass Dr. Rife weder seine Maschine noch seine Frequenzen patentieren konnte. Die Maschinen von Dr. Rife waren zu seiner Zeit Standardgeräte zur Frequenzerzeugung. Die Technologie zur Erzeugung von Frequenzen war seit vielen Jahren gemeinfrei, was Dr. Rife davon abhielt, seine Maschine patentieren zu lassen. Um die komplette Geschichte seiner Instrumente zu erfahren, lesen Sie "The Rife Machine Report" auf dieser Seite. Wenn Sie die ganze Geschichte über diese höheren Audiofrequenzen erfahren möchten, dann lesen Sie Kapitel 11 von "The Rife Machine Report".

Die Häufigkeiten, die Dr. Rife für die verschiedenen Mikroorganismen fand, galten ebenfalls als nicht patentierbar, da sie natürlich in der Natur vorkommen. Die FCC

hat tatsächlich eine unmittelbare Domain über alle Frequenzen in den USA und wird dort nur von Lizenzen genutzt. Da es keinen Patentschutz gab, fand Philip Hoyland einen Weg, die wahren Frequenzen von Dr. Rife zu verbergen, indem er Audiofrequenzen verwendete, um die richtigen hohen HF-Frequenzen zu erzeugen, indem er Seitenbänder verwendete. Die Tatsache, dass Philip Hoyland diese Hochfrequenz-Seitenband-Methode verwendete, um Dr. Rifes wahre Frequenzen zu verbergen, und sie niemals Dr. Rife oder irgendjemand anderem offenbarte, ist der Grund, warum die Menschen fälschlicherweise geglaubt haben, dass diese höheren niedrigen Audiofrequenzen Dr. Rifes wahre Primärfrequenzen seien, die die Krankheiten beseitigen würden.

Aufgrund dessen, was erklärt wurde, verwenden die Menschen heute immer noch diese höheren tiefen Audiofrequenzen und glauben fälschlicherweise, dass es sich um Dr. Rifes wahre Frequenzen handelt. Sie verstehen nicht, dass sie mit einer harmonischen Trägerfrequenz von 3,30 Megahertz verwendet werden müssen, um die wahren Frequenzen von Dr. Rife zu erzeugen. Um die vollständigen historischen Informationen darüber zu erfahren, wie dies geschah, lesen Sie das gesamte Dokument auf dieser Website mit dem Titel "The Rife Machine Report". Um mehr über das volle Potenzial dieser Beam Ray Clinical-Maschine zu erfahren, lesen Sie die Seite "Dr. Rife und Philip Hoyland's 3.30 MHz sweep". Das volle Potenzial dieses klinischen Strahlgeräts beginnt gerade erst verstanden zu werden.

Es gab noch ein weiteres Geheimnis, das Philip Hoyland nicht preisgeben wollte, als er das Rife Ray #5 oder Beam Ray Clinical Instrument baute. Als er diese neue Art von Beam Ray Clinical Instrument entwickelte, verwendete er nicht Dr. Rifes originales M.O.R. Frequenzen, die im Rife Ray #3 oder im Rife Ray #4 verwendet wurden. Was er tat, war, höhere harmonische Frequenzen zu verwenden, die auf Dr. Rifes ursprünglichen M.O.R.-Frequenzen basierten. Es ist klar, dass Dr. Rife wusste und darüber sprach, dass seine Frequenzen Subharmonische von echten höheren Frequenzen waren. Philip Hoyland muss Dr. Rife zugehört haben, als er darüber sprach, dass seine Frequenzen nur Sub-Harmonische von echten höheren Frequenzen waren, und erkannte, dass er diese höheren Harmonischen als die neuen M.O.R.-Frequenzen in einem neuen Instrument verwenden konnte. Es ist auch offensichtlich, dass Philip Hoyland durch Tests herausfand, dass jede von Dr. Rifes Frequenzen eine Subharmonische einer wirklich höheren Frequenz war. Mit diesem Verständnis und dem Wissen, dass jede höhere Harmonische von Dr. Rifes Frequenzen als M.O.R. verwendet werden konnte, baute Philip Hoyland 1936 das neue Rife Ray #5 oder Beam Ray Clinical Instrument und verwendete diese höheren harmonischen Frequenzen als neue Primärfrequenzen in den neuen Maschinen.

In den nächsten drei Diagrammen, die unten gezeigt werden, sehen Sie die Primärfrequenzen von Dr. Rife und die vielen harmonischen Frequenzen, die auch als Primärfrequenzen verwendet werden können. Die erste Frequenz, die unter jedem Organismus aufgeführt ist, ist Dr. Rifes primäre Frequenz für diesen Organismus. Die Frequenzen mit dem einzelnen Sternchen* wurden als Primärfrequenzen in der Replik des Aubrey Scoon Beam Ray Clinical Instruments

verwendet, die die feste Trägerfrequenz von 3,30 Megahertz verwendete. Die Frequenzen mit dem doppelten Sternchen** wurden als Primärfrequenzen in dem 2008 gefundenen Original Beam Ray Clinical Instrument verwendet, das eine feste Trägerfrequenz von 3,80 Megahertz verwendete. Einige der gleichen Frequenzen wurden in beiden Maschinen verwendet, und diese haben sowohl das einfache als auch das doppelte Sternchen.

Aufgrund der Entdeckungen von Dr. Rife und Philip Hoylands Verwendung von harmonischen Frequenzen wissen wir, dass jede Frequenz, die in diesen drei Diagrammen bis zur 20. harmonischen Frequenz gezeigt wird, als primäre Frequenz M.O.R. für diese Organismen verwendet werden kann. Diejenigen, die einen Frequenzgenerator haben, der diese Frequenzen ausgeben kann, möchten vielleicht diese Frequenzen verwenden. Bitte denken Sie daran, dass Philip Hoyland die Frequenzen bis zur 20. Harmonischen bei einigen Organismen in seinen Beam Ray Clinical Instrumenten verwendete. Daher ist davon auszugehen, dass Oberschwingungen verwendet werden können, die höher sind. Wie hohe Oberschwingungen verwendet werden können, ist nicht bekannt. Wenn Sie eine Kopie dieser drei Diagramme mit höherer Auflösung wünschen, klicken Sie auf: Diagramm 1, Diagramm 2, Diagramm 3.

Streptothrix		Anthrax		B or E Coli Rod		B or E Coli Viurs		BX Cancer Virus		BY Cancer Organism	
1	191803	1	139200	1	416510	1	769035	1	1607450	1	1529520
2	383606	2	278400	2	833020	2	1538070	2	* **3214900	2	* **3059040
3	575409	3	417600	3	1249530	3	2307105	3	4822350	3	4588560
4	767212	4	556800	4	1666040	4	*3076140	4	6429800	4	6118080
5	959015	5	696000	5	2082550	5	**3845175	5	8037250	5	7647600
6	1150818	6	835200	6	2499060	6	4614210	6	9644700	6	9177120
7	1342621	7	974400	7	2915570	7	5383245	7	11252150	7	10706640
8	1534424	8	1113600	8	*3332080	8	6152280	8	12859600	8	12236160
9	1726227	9	1252800	9	**3748590	9	6921315	9	14467050	9	13765680
10	1918030	10	1392000	10	4165100	10	7690350	10	16074500	10	15295200
11	2109833	11	1531200	11	4581610	11	8459385	11	17681950	11	16824720
12	2301636	12	1670400	12	4998120	12	9228420	12	19289400	12	18354240
13	2493439	13	1809600	13	5414630	13	9997455	13	20896850	13	19883760
14	2685242	14	1948800	14	5831140	14	10766490	14	22504300	14	21413280
15	2877045	15	2088000	15	6247650	15	11535525	15	24111750	15	22942800
16	3068848	16	2227200	16	6664160	16	12304560	16	25719200	16	24472320
17	*3260651	17	2366400	17	7080670	17	13073595	17	27326650	17	26001840
18	3452454	18	2505600	18	7497180	18	13842630	18	28934100	18	27531360
19	3644257	19	2644800	19	7913690	19	14611665	19	30541550	19	29060880
20	**3836060	20	2784000	20	8330200	20	15380700	20	32149000	20	30590400
21	4027863	21	2923200	21	8746710	21	16149735	21	33756450	21	32119920
22	4219666	22	3062400	22	9163220	22	16918770	22	35363900	22	33649440
23	4411469	23	3201600	23	9579730	23	17687805	23	36971350	23	35178960
24	4603272	24	*3340800	24	9996240	24	18456840	24	38578800	24	36708480
25	4795075	25	3480000	25	10412750	25	19225875	25	40186250	25	38238000
26	4986878	26	3619200	26	10829260	26	19994910	26	41793700	26	39767520
27	5178681	27	**3758400	27	11245770	27	20763945	27	43401150	27	41297040
28	5370484	28	3897600	28	11662280	28	21532980	28	45008600	28	42826560
29	5562287	29	4036800	29	12078790	29	22302015	29	46616050	29	44356080
30	5754090	30	4176000	30	12495300	30	23071050	30	48223500	30	45885600
31	5945893	31	4315200	31	12911810	31	23840085	31	49830950	31	47415120
32	6137696	32	4454400	32	13328320	32	24609120	32	51438400	32	48944640
33	6329499	33	4593600	33	13744830	33	25378155	33	53045850	33	50474160
34	6521302	34	4732800	34	14161340	34	26147190	34	54653300	34	52003680

	Gonorrhea	Spinal Meningitis	Staph Pyo Aureus	Strept Pyogenes	Syphilis
1	233000	426862	477660	719150	788700
2	466000	853724	955320	1438300	1577400
3	699000	1280586	1432980	2157450	2366100
4	932000	1707448	1910640	2876600	*3154800
5	1165000	2134310	2388300	* **3595750	**3943500
6	1398000	2561172	2865960	4314900	4732200
7	1631000	2988034	*3343620	5034050	5520900
8	1864000	*3414896	**3821280	5753200	6309600
9	2097000	**3841758	4298940	6472350	7098300
10	2330000	4268620	4776600	7191500	7887000
11	2563000	4695482	5254260	7910650	8675700
12	2796000	5122344	5731920	8629800	9464400
13	3029000	5549206	6209580	9348950	10253100
14	*3262000	5976068	6687240	10068100	11041800
15	3495000	6402930	7164900	10787250	11830500
16	**3728000	6829792	7642560	11506400	12619200
17	3961000	7256654	8120220	12225550	13407900
18	4194000	7683516	8597880	12944700	14196600
19	4427000	8110378	9075540	13663850	14985300
20	4660000	8537240	9553200	14383000	15774000
21	4893000	8964102	10030860	15102150	16562700
22	5126000	9390964	10508520	15821300	17351400
23	5359000	9817826	10986180	16540450	18140100
24	5592000	10244688	11463840	17259600	18928800
25	5825000	10671550	11941500	17978750	19717500
26	6058000	11098412	12419160	18697900	20506200
27	6291000	11525274	12896820	19417050	21294900
28	6524000	11952136	13374480	20136200	22083600
29	6757000	12378998	13852140	20855350	22872300
30	6990000	12805860	14329800	21574500	23661000
31	7223000	13232722	14807460	22293650	24449700
32	7456000	13659584	15285120	23012800	25238400
33	7689000	14086446	15762780	23731950	26027100
34	7922000	14513308	16240440	24451100	26815800

	Tetanus	Tuberculosis Rod	Tuberculosis Virus	Typhoid Rod	Typhoid Virus
1	234000	369433	769000	759450	1445180
2	468000	738866	1538000	1518900	*2890360
3	702000	1108299	2307000	2278350	**4335540
4	936000	1477732	*3076000	*3037800	5780720
5	1170000	1847165	**3845000	**3797250	7225900
6	1404000	2216598	4614000	4556700	8671080
7	1638000	2586031	5383000	5316150	10116260
8	1872000	2955464	6152000	6075600	11561440
9	2106000	*3324897	6921000	6835050	13006620
10	2340000	**3694330	7690000	7594500	14451800
11	2574000	4063763	8459000	8353950	15896980
12	2808000	4433196	9228000	9113400	17342160
13	3042000	4802629	9997000	9872850	18787340
14	*3276000	5172062	10766000	10632300	20232520
15	3510000	5541495	11535000	11391750	21677700
16	**3744000	5910928	12304000	12151200	23122880
17	3978000	6280361	13073000	12910650	24568060
18	4212000	6649794	13842000	13670100	26013240
19	4446000	7019227	14611000	14429550	27458420
20	4680000	7388660	15380000	15189000	28903600
21	4914000	7758093	16149000	15948450	30348780
22	5148000	8127526	16918000	16707900	31793960
23	5382000	8496959	17687000	17467350	33239140
24	5616000	8866392	18456000	18226800	34684320
25	5850000	9235825	19225000	18986250	36129500
26	6084000	9605258	19994000	19745700	37574680
27	6318000	9974691	20763000	20505150	39019860
28	6552000	10344124	21532000	21264600	40465040
29	6786000	10713557	22301000	22024050	41910220
30	7020000	11082990	23070000	22783500	43355400
31	7254000	11452423	23839000	23542950	44800580
32	7488000	11821856	24608000	24302400	46245760
33	7722000	12191289	25377000	25061850	47690940
34	7956000	12560722	26146000	25821300	49136120

Da die Seitenbandmethode, die Philip Hoyland für das Beam Ray-Instrument verwendet hat, etwas schwer zu verstehen ist, haben wir unten einige Seitenbanddiagramme erstellt, die das Verständnis erleichtern. In der nächsten Grafik zeigen wir, wie das Beam Ray Clinical M.O.P.A.-Instrument die primäre Frequenz des BX-Krebsvirus (Karzinom) von 3.214.900 Hertz erzeugte. Das

ursprüngliche Beam Ray Clinical Instrument war nicht nur in der Lage, Seitenbänder zu erzeugen, sondern auch harmonische Seitenbänder. Die Fähigkeit dieses Instruments, harmonische Seitenbänder zu erzeugen, ermöglichte es Philip Hoyland, eine feste Trägerfrequenz von 3,30 Megahertz (3.300.000 Hertz) zu verwenden und diese Trägerfrequenz mit einer Audiofrequenz von 21.275 Hertz zu modulieren (zu kombinieren), um die BX-Krebsvirus-Primärfrequenz von 3.214.900 Hertz zu erzeugen (dies war Dr. Rifes primäre BX-Frequenz von 1.607.450 Hertz multipliziert mit 2). Was im Beam Ray-Instrument passiert, ist, dass die Audiofrequenz von 21.275 Hertz viele Seitenbandfrequenzen erzeugt, die genau 21.275 Hertz voneinander entfernt sind. Die 4. untere Seitenbandfrequenz, die sich aus 21.275 Hertz ergibt, ist die primäre Frequenz des BX-Krebsvirus von 3.214.900 Hertz. Mit dieser Methode war Philip Hoyland in der Lage, Audiofrequenzen zu verwenden, die mit einer Trägerfrequenz von 3,30 Megahertz moduliert oder kombiniert wurden, um alle Primärfrequenzen von Dr. Rife durch Seitenbänder zu erzeugen.

BITTE BEACHTEN SIE: Jede Leitung, mit Ausnahme der 3,30-MHz-Trägerfrequenzleitung, stellt eine Seitenbandfrequenz dar. Wir haben die Frequenz nicht für jedes Seitenband notiert, damit wir die Seitenbandfrequenz deutlich anzeigen können, die die richtige Frequenz erzeugt, die den Mikroorganismus devitalisieren oder unschädlich machen würde.

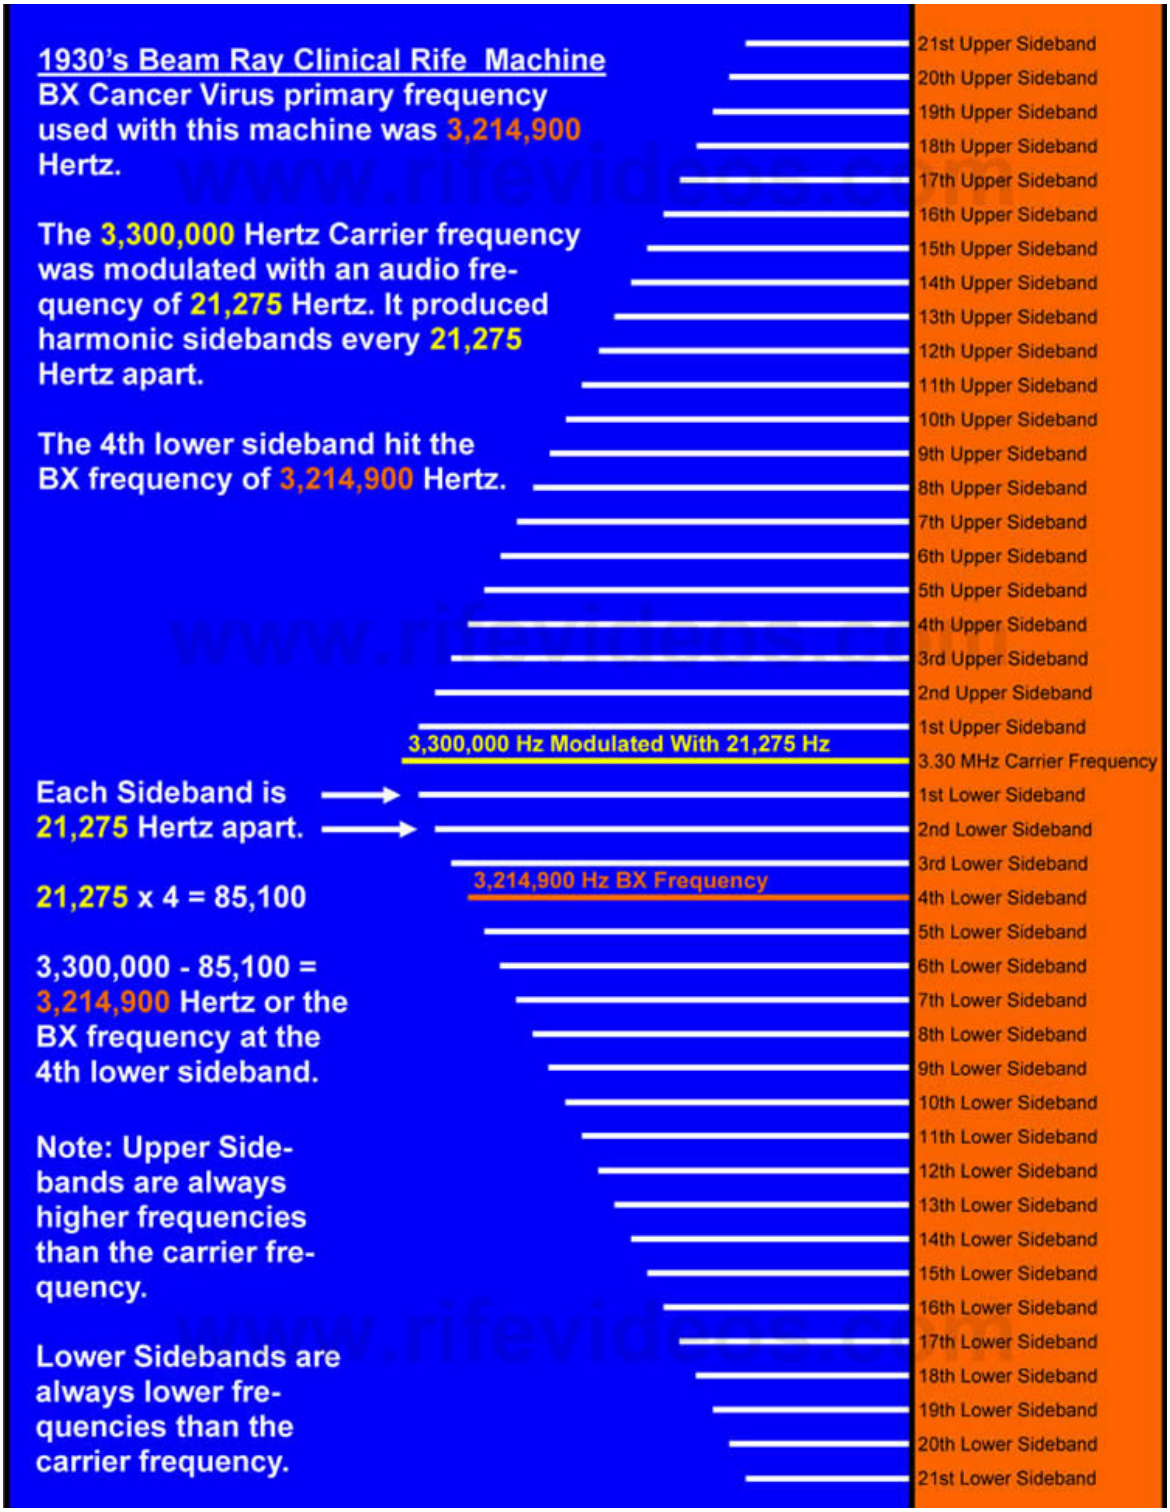

In der nächsten Grafik, die unten gezeigt wird, werden wir zeigen, wie das Beam Ray Clinical M.O.P.A.-Instrument die primäre Frequenz des BY-Krebsorganismus (Sarkom) von 3.059.040 Hertz (die primäre Frequenz des primären BY-Organismus von Dr. Rife von 1.529.520 Hertz multipliziert mit 2) unter Verwendung einer Audiofrequenz von 20.080 erzeugte. Die Audiofrequenz von 20.080 Hertz erzeugt viele Seitenbandfrequenzen, die genau 20.080 Hertz voneinander entfernt sind. Die 12. untere Seitenbandfrequenz, die von 20.080 Hertz erzeugt wird, ist die Primärfrequenz des BY-Krebsorganismus von 3.059.040 Hertz.

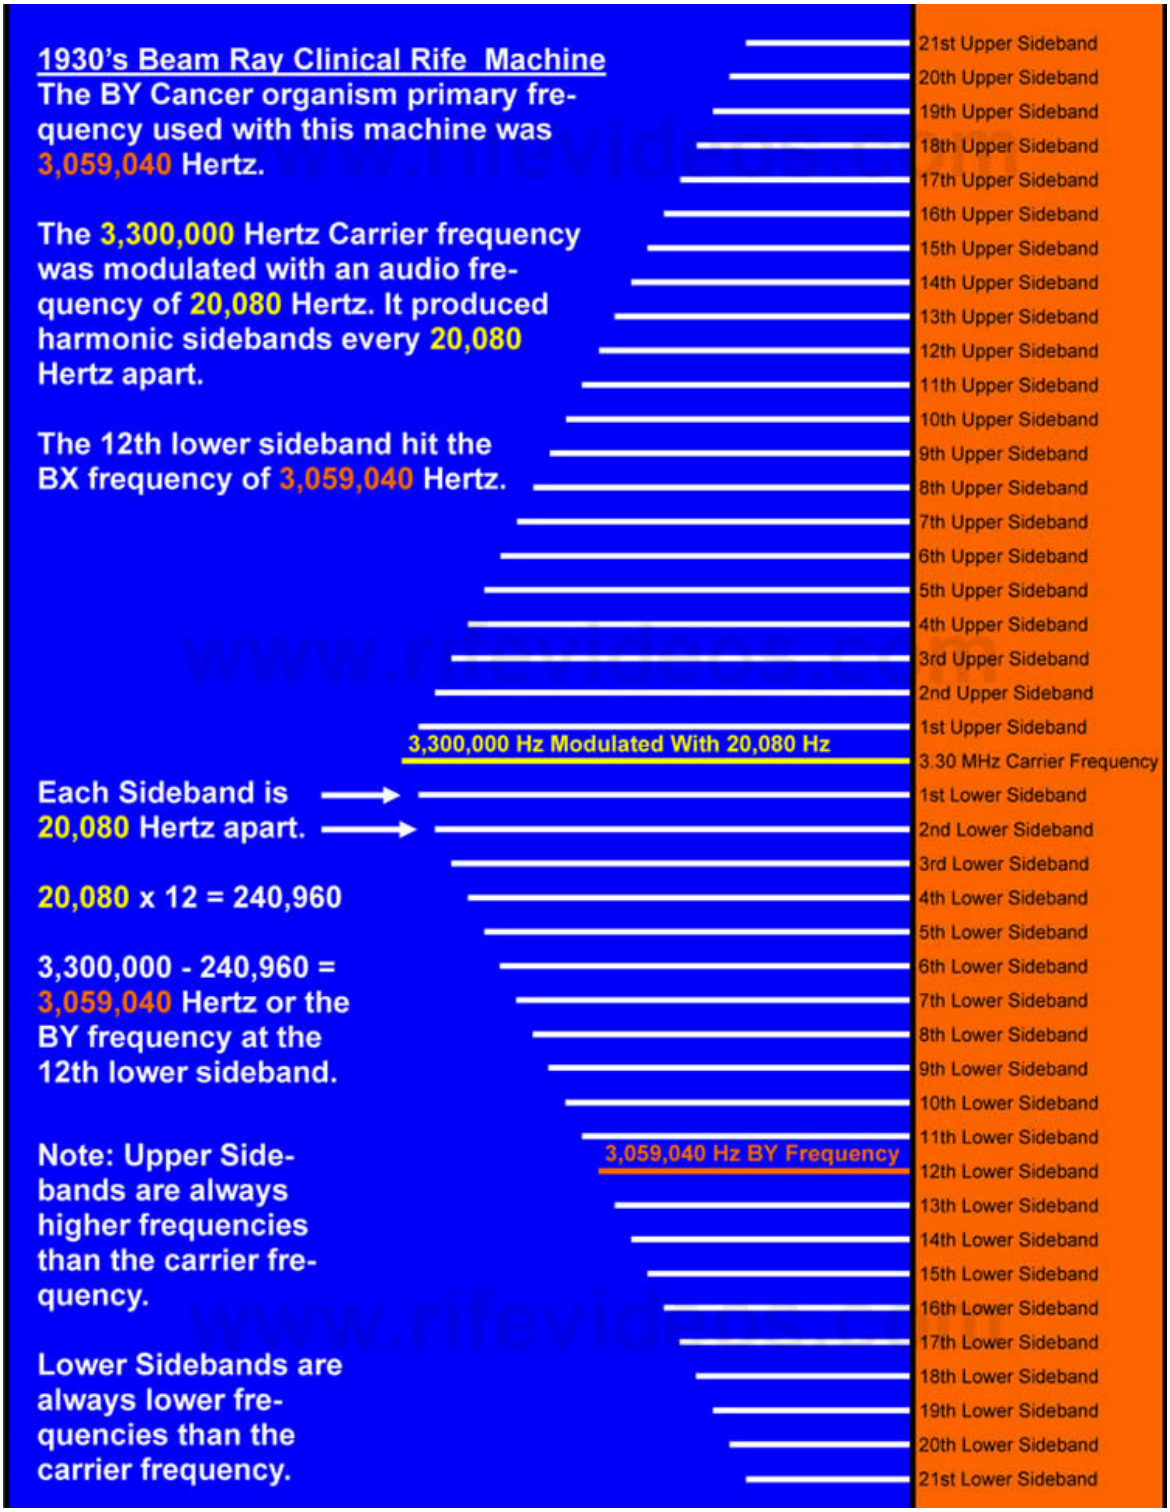

In der nächsten Grafik, die unten gezeigt wird, zeigen wir, wie das Beam Ray Clinical M.O.P.A.-Instrument die Streptothrix-Primärfrequenz von 3.260.650 Hertz (Dr. Rifes primäre Streptothrix-Frequenz von 191.803 Hertz multipliziert mit 17) unter Verwendung einer Audiofrequenz von 7.870 Hertz erzeugte. Die Audiofrequenz von 7.870 Hertz erzeugt viele Seitenbandfrequenzen, die genau 7.870 Hertz voneinander entfernt sind. Die 5. untere Seitenbandfrequenz, die sich aus 7.870 Hertz ergibt, ist die Streptothrix-Primärfrequenz von 3.260.650 Hertz.

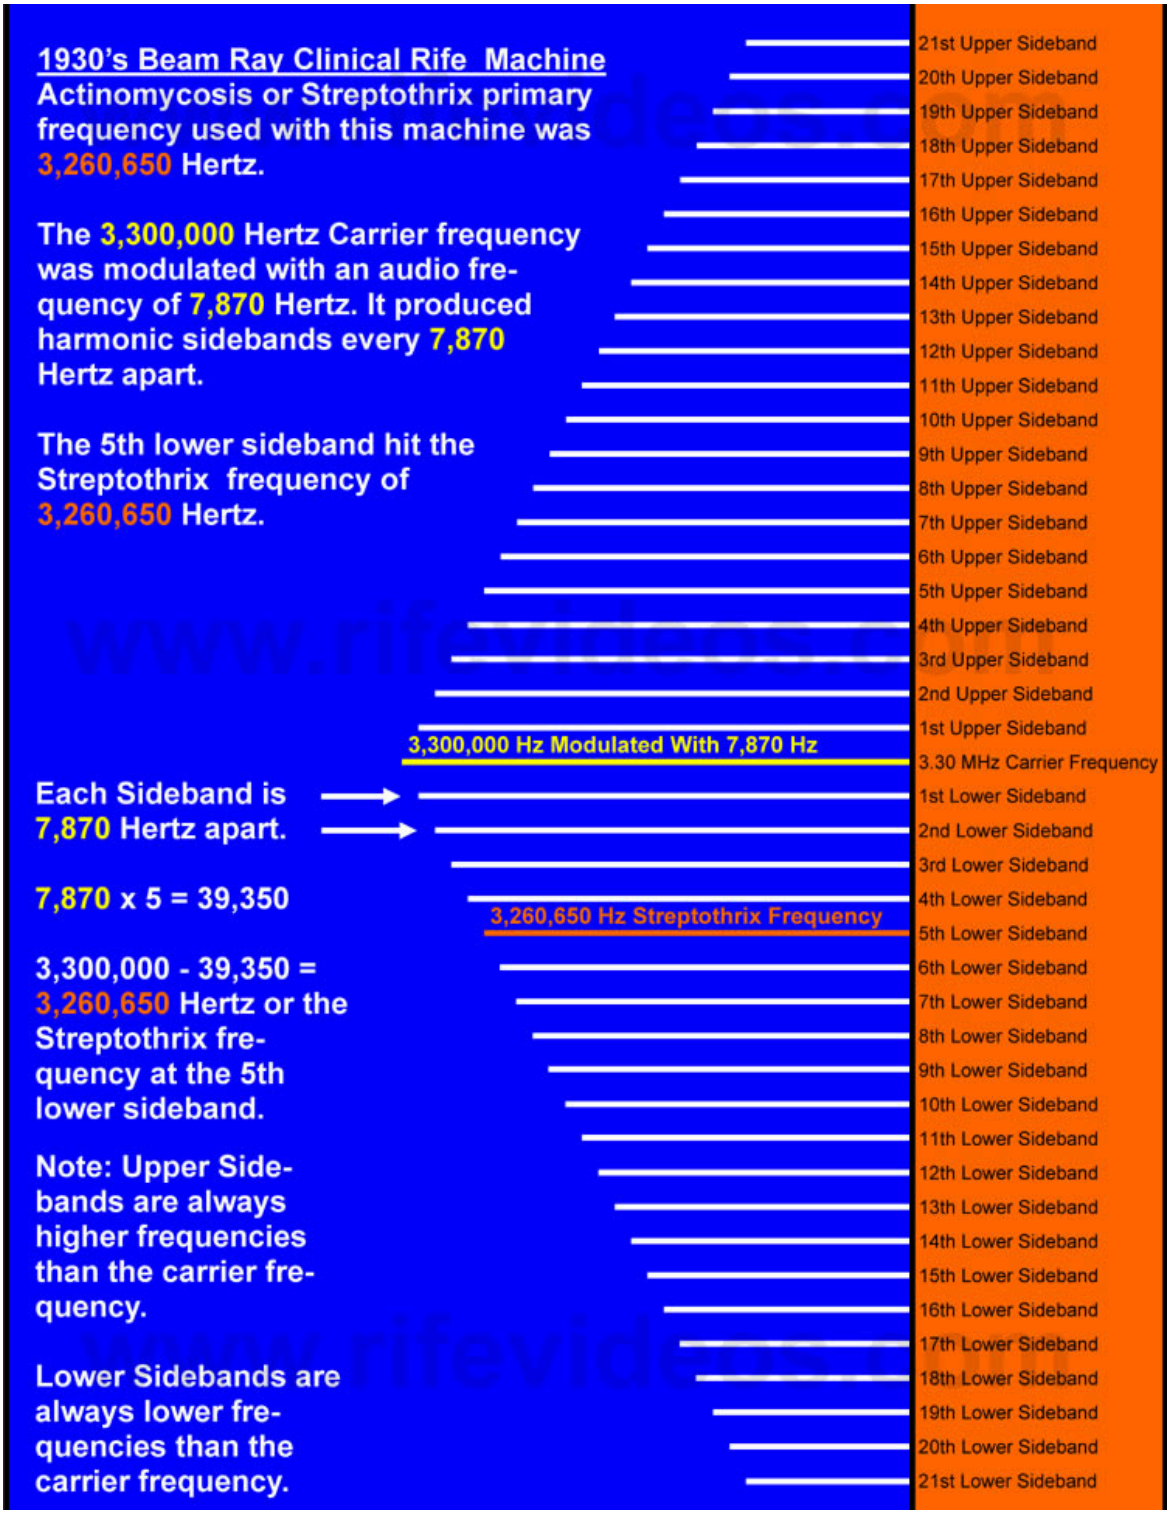

Das nächste Seitenbanddiagramm (siehe unten) zeigt, wie das Beam Ray Clinical M.O.P.A.-Instrument die E. Coli-Primärfrequenz von 3.332.080 Hertz (Dr. Rife's primäre E. Coli-Frequenz von 416.510 Hertz multipliziert mit 8) unter Verwendung einer Audiofrequenz von 8.020 Hertz erzeugte. Die Audiofrequenz von 8.020 Hertz erzeugt viele Seitenbandfrequenzen, die genau 8.020 Hertz voneinander entfernt sind. Die 4. obere Seitenbandfrequenz, die sich aus 8.020 Hertz ergibt, ist die E. Coli-Primärfrequenz von 3.332.080 Hertz.

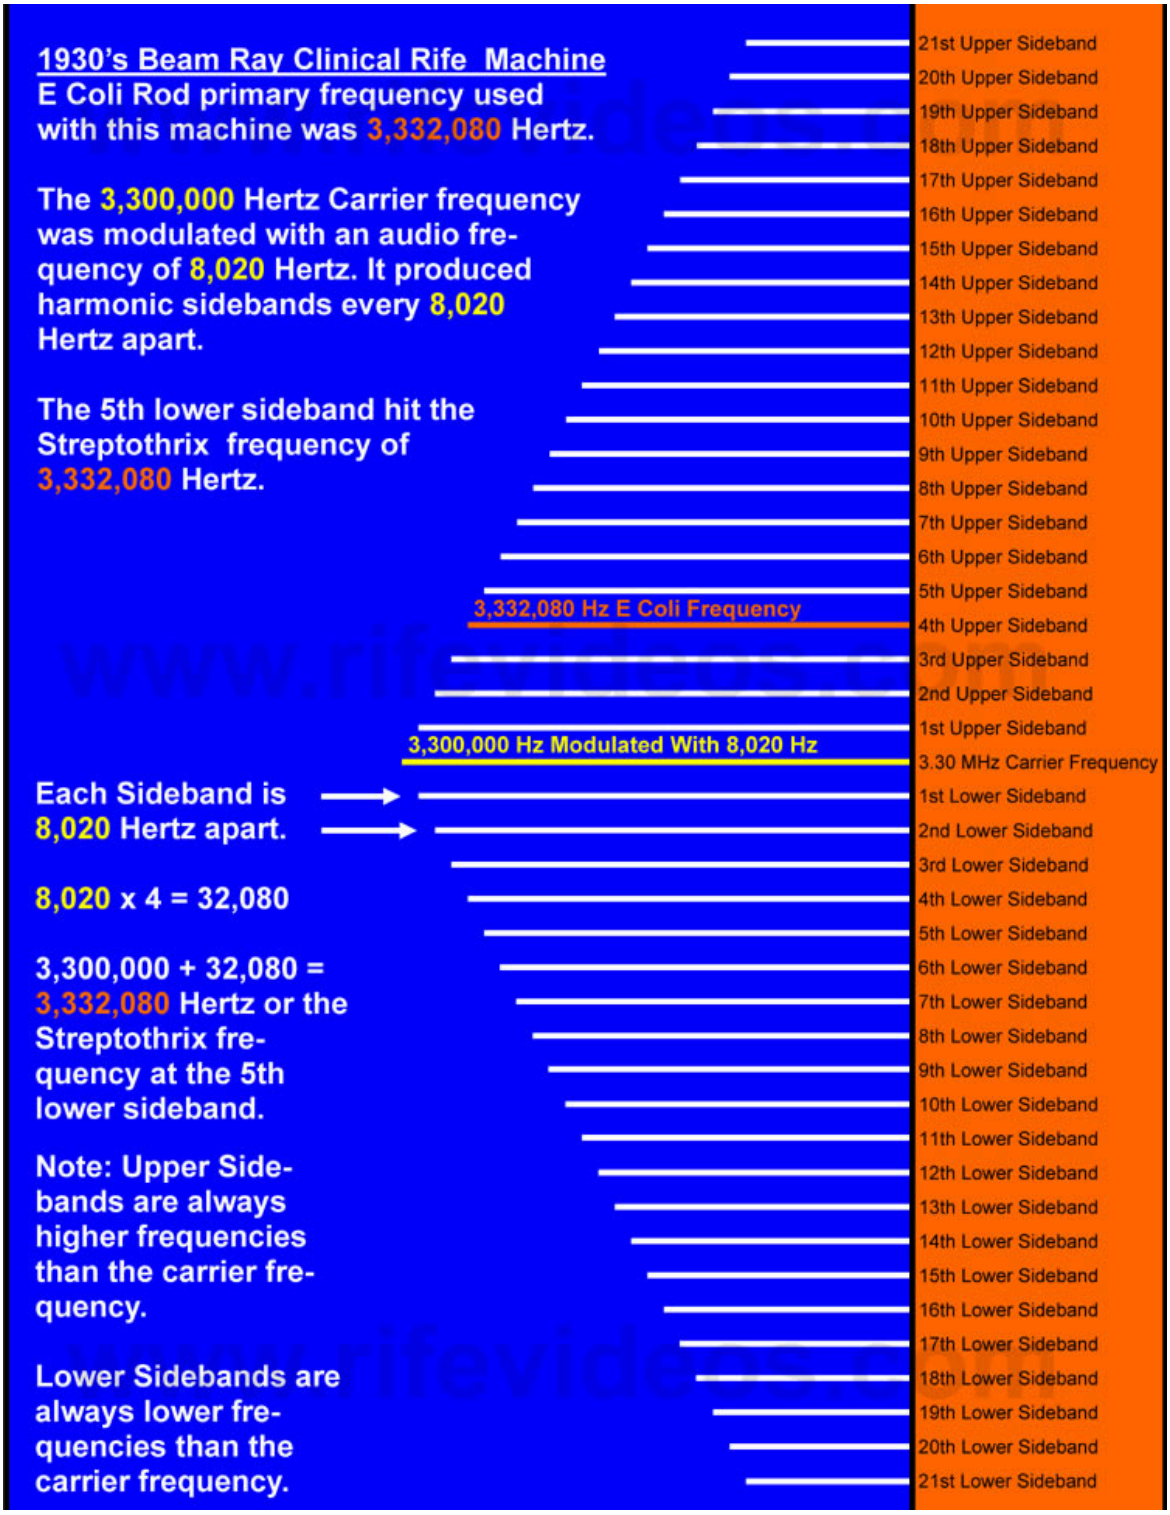

In der letzten Seitenband-Tabelle, die unten gezeigt wird, zeigen wir, wie das Beam Ray Clinical M.O.P.A.-Instrument die primäre Lungenentzündungsfrequenz von 3.414.900 Hertz (Dr. Rife's primäre Lungenentzündungsfrequenz von 426.862 Hertz multipliziert mit 8) unter Verwendung einer Audiofrequenz von 7.660 Hertz erzeugte. Die Audiofrequenz von 7.660 Hertz erzeugt viele Seitenbandfrequenzen, die genau 7.660 Hertz voneinander entfernt sind. Die 15. obere Seitenbandfrequenz, die sich aus 7.660 Hertz ergibt, ist die Streptothrix-Primärfrequenz von 3.414.900 Hertz.

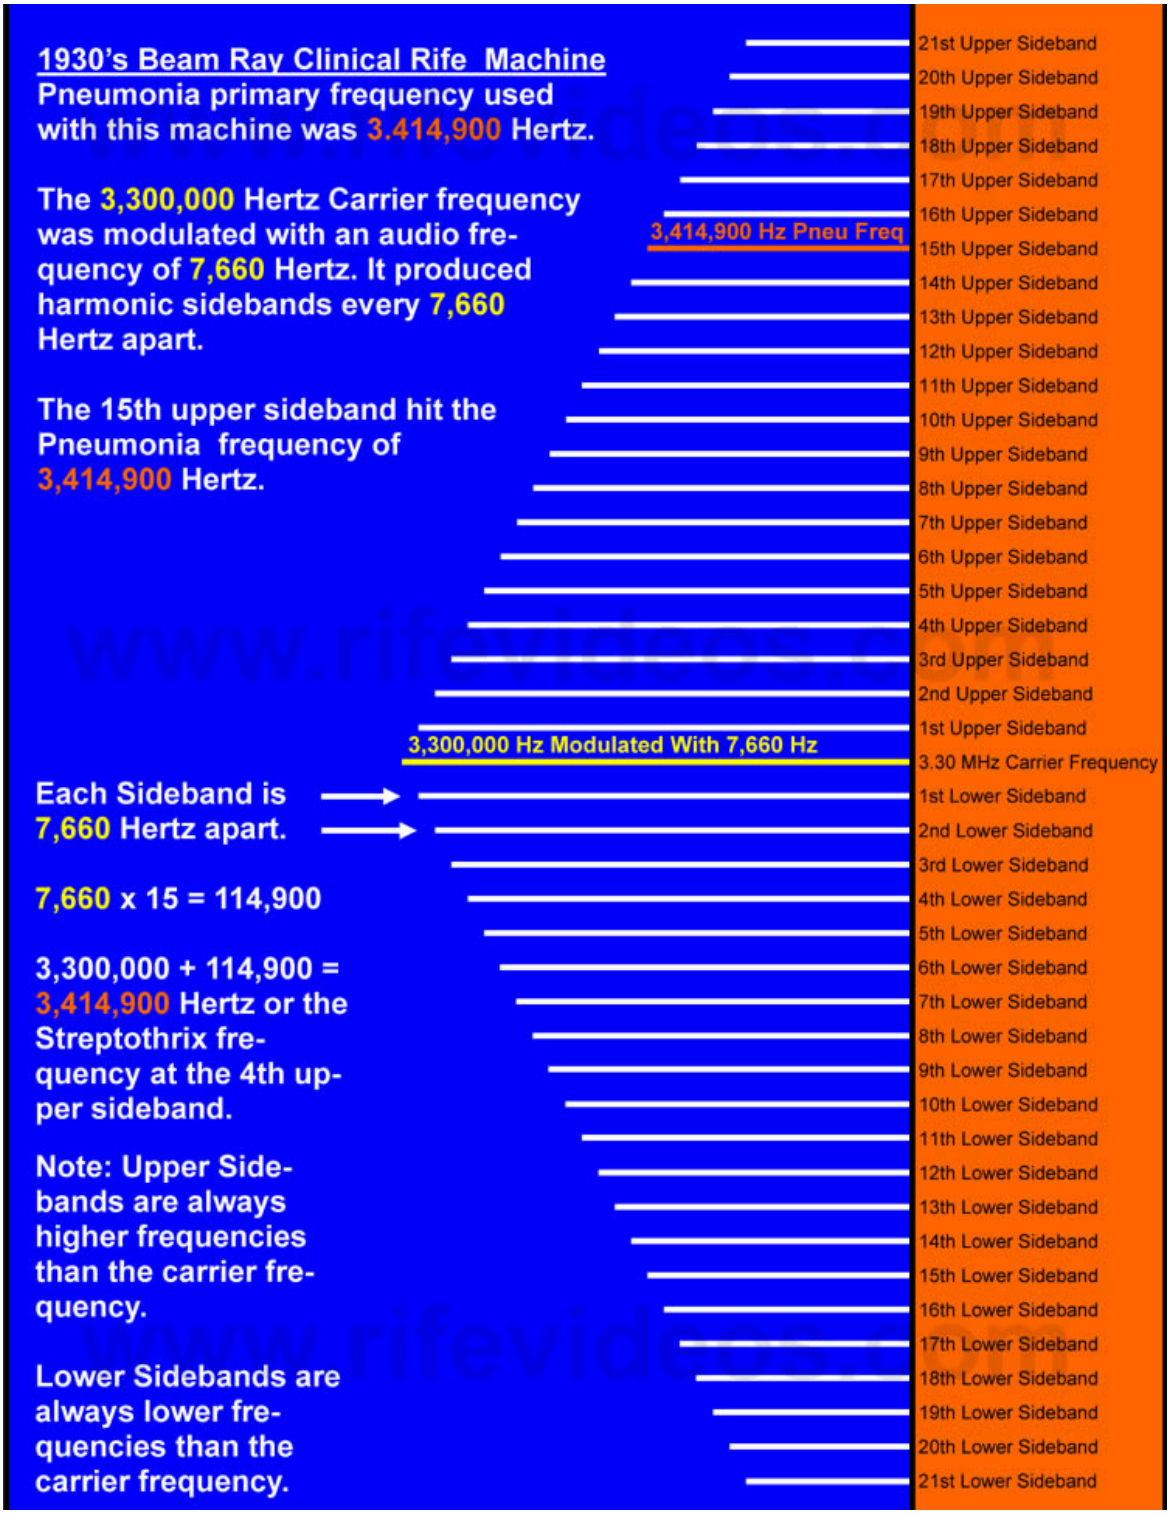

Wir hätten alle Diagramme für jeden einzelnen von Dr. Rifes Organismen erstellen können, aber die fünf, die wir oben gezeigt haben, zeigen, wie das Rife Ray #5 oder Beam Ray Clinical Instrument funktionierte. Diese Diagramme und Frequenzen zeigen genau, wie das Beam Ray Clinical Instrument von Dr. Rife funktionierte. Keine der tiefen Tonfrequenzen, die in einem der Rife Ray #5 Beam Ray Instrumente verwendet wurden, war für die Behandlung von Krankheiten bestimmt. Die oben gezeigten Diagramme beweisen, dass die niedrigen Audiofrequenzen verwendet wurden, um die Seitenbänder mit hoher HF-Frequenz zu erzeugen. Es waren diese hohen HF-Seitenbandfrequenzen, die die Mikroorganismen abtöteten, devitalisierten oder unschädlich machten. Das Beam Ray Clinical Rife Instrument war in der Lage, die Frequenzen für alle bekannten

und unbekannten Mikroorganismen von Dr. Rife zu erzeugen. Um herauszufinden, wie dieses Instrument dies tun könnte, lesen Sie die Seite "Dr. Rife and Phlip Hoyland's 3.30 MHz sweep".

Wenn ein Frequenzgenerator nicht den vollen Bereich der Radiofrequenzen ausgeben kann, kann er nicht nach den Prinzipien oder Methoden von Dr. Rife arbeiten. Diese Frequenzen, die wir auf dieser Seite gezeigt haben, können nur auf zwei Arten erzeugt werden, entweder direkt oder über Seitenbänder. Es gibt heute nur wenige Frequenzgeneratoren auf dem Markt, die die Originalfrequenzen von Dr. Rife oder die Oberschwingungen von Dr. Rifes Originalfrequenzen ausgeben können, die auf dieser Seite gezeigt werden.

Uns ist heute kein Frequenzgenerator auf dem Markt bekannt, den die Hersteller als "Rife Machines" bezeichnen, der diese Frequenzen ausgeben kann. Es gibt Frequenzgeneratoren, die NICHT als "Rife Machines" bezeichnet werden und diese Frequenzen ausgeben können. Stellen Sie sicher, dass jeder Frequenzgenerator, den Sie kaufen möchten, die hohen HF-Frequenzen von Dr. Rife ausgeben kann. Wenn die Hersteller behaupten, dass sie diese HF-Frequenzen nur mit niedrigen Rechteckwellen-Audiofrequenzen erzeugen können, ohne eine Trägerfrequenz zu verwenden, dann können Sie ohne jeden Zweifel wissen, dass ihre Maschine nicht die Originalfrequenzen von Dr. Rife ausgeben kann. Wenn jemand versteht, wie diese Originalmaschinen funktionieren, und Sie sich entscheiden, eines der vielen Niederfrequenzinstrumente zu kaufen, die heute auf dem Markt als "Rife Machines" verkauft werden, werden Sie später nicht enttäuscht sein. Für Frequenzgeneratoren, die die originalen hohen HF-Frequenzen von Dr. Rife ausgeben können, klicken Sie hier.

Die letzte Tabelle, die unten gezeigt wird, enthält noch niedrigere Audiofrequenzen, von denen die Leute fälschlicherweise geglaubt haben, dass sie die wahren Frequenzen von Dr. Rife sind. Wir werden nun eine kurze Geschichte geben, wie es zu diesem Fehler kam. Wenn Sie die ganze Geschichte lesen möchten, lesen Sie Kapitel 12 von "The Rife Machine Report".

In den 1950er Jahren gründeten Dr. Rife, John Crane und John Marsh ein Unternehmen namens Life Labs. Sie begannen wieder mit dem Bau des Beam Ray Clinical Instruments. Im Jahr 1935 wurde die FCC vom Kongress gegründet und sie begannen ab 1936, die Radiowellen zu kontrollieren. Da die FCC eine kleine Behörde war, dauerte es mehrere Jahre, bis sie endlich zu der Behörde wurde, die sie heute ist. In den 1930er Jahren konnte Philip Hoyland jede beliebige Trägerfrequenz für das Beam Ray Clinical Instrument wählen. Wir wissen, dass er zwei verschiedene Trägerfrequenzen verwendete: 3,30 Megahertz und 3,80 Megahertz.

In den 1950er Jahren gründeten Dr. Rifes Partner, John Crane und John Marsh, Life Labs. Sie mussten bei der FCC eine neue Trägerfrequenz beantragen, die für den Wiederaufbau des Rife Ray #5 oder Beam Ray Clinical Instruments verwendet werden sollte. Sie erhielten 4,68 Megahertz als neue Trägerfrequenz

für dieses neue Instrument aus den 1950er Jahren. Das Problem war, dass die höheren Audiofrequenzen, die mit der ursprünglichen 3,30-Megahertz-Trägerfrequenz verwendet wurden, nicht richtig mit der neuen 4,68-Megahertz-Trägerfrequenz übereinstimmten.

Da Dr. Rife, John Crane und John Marsh die Seitenbandmethode von Philip Hoyland nicht verstanden, erkannten sie nicht, dass die höheren Audiofrequenzen neu berechnet werden mussten, um mit der neuen Trägerfrequenz von 4,68 Megahertz zu arbeiten, weshalb das neue Instrument aus den 1950er Jahren nicht richtig funktionierte. Aus unerfindlichen Gründen, die wir nicht verstehen, beschlossen sie, die höheren Audiofrequenzen um das 10-fache zu senken. Dann änderten sie die Sinuswellen-Wellenform dieser niedrigeren Audiofrequenzen in die Rechteckwellen-Wellenform. Die Absenkung dieser Frequenzen führte dazu, dass die neuen niedrigeren Audiofrequenzen nie richtig funktionierten, um die von Philip Hoyland entwickelte Seitenbandmethode zu erzeugen. Durch die Senkung der Audiofrequenzen wurde nur noch die Rechteckfrequenz zur Behandlung der verschiedenen Organismen verwendet.

Dieser Wechsel von hohen Audiofrequenzen zu noch niedrigeren Audiofrequenzen führte dazu, dass die Hochfrequenz-Seitenbandmethode nicht mehr verwendet wurde. Wegen dieser Fehler haben die Leute auch viele Jahre lang diese niedrigeren Rechteckwellen-Audiofrequenzen verwendet, in dem Glauben, dass es sich um Dr. Rifes wahre Frequenzen handelt. Heute verwenden fast alle Hersteller der vielen sogenannten "Rife Machines" nur noch diese niedrigeren Audiofrequenzen. Das liegt daran, dass sie nicht wissen, wie das Originalinstrument funktionierte. Weil sie nicht wissen, wie die ursprünglichen Maschinen funktionierten, geben sie ihren Kunden immer noch diese niedrigen Audiofrequenzen, ohne zu verstehen, dass es sich nicht um die wahren Frequenzen von Dr. Rife handelt. Aus diesem Grund haben wir diese Informationen auf dieser Seite gegeben, damit jeder, der sie liest, weiß, welche Frequenzen Dr. Rifes wahre Originalfrequenzen sind und welche nicht.

Um die vollständigen historischen Informationen darüber zu erfahren, wie die niedrigeren Audiofrequenzen der 1950er Jahre fälschlicherweise für Dr. Rifes ursprüngliche Frequenzen gehalten wurden, lesen Sie Kapitel 12 des "The Rife Machine Report".

Low Audio Square Wave Frequencies Incorrectly Believed To Be Dr. Rife's True Frequencies. No Fixed Carrier Frequency Will Make Them Produce Dr. Rife's True Frequencies Using The Sideband Method Because They Are Too Low.			
B or E Coli Rod	800Hz	Streptothrix	784 Hz
B or E Coli Virus	1552 Hz	Syphilis or Treponema	660 Hz
BX Virus Carcinoma	2128 Hz	Tetanus	120 Hz
BY Sarcoma	2008 Hz	Tuberculosis Rod	803 Hz
Gonorrhea	712 Hz	Tuberculosis Virus	1552 Hz
Pneumonia or Spinal Meningitis	776 Hz	Typhoid Rod	712 Hz
Staphylococcus	727 Hz	Typhoid Virus	1862 Hz
Streptococcus	880 Hz		

Bis in die 1950er Jahre basierten alle Maschinenfrequenzen von Dr. Rife auf seinen "Original High Frequencies", die in der ersten Tabelle auf dieser Seite dargestellt sind. Obwohl Philip Hoyland seine höheren harmonischen Frequenzen auf der Verwendung einer festen Trägerfrequenz in Kombination mit hohen Audiofrequenzen basierte, um Seitenbänder zu erzeugen, arbeiteten die Maschinen immer noch nach Dr. Rifes Prinzip der koordinativen Resonanz. Die niedrigen Rechteckfrequenzen haben nie die Ergebnisse erreicht, die in der Klinik von 1934 erzielt wurden, und funktionieren nicht nach dem Prinzip der koordinativen Resonanz, das Dr. Rife mit seinen hohen HF-Frequenzen verwendete. Dr. Robert P. Stafford, M.D., war einer der ersten Ärzte, der das neue Instrument aus den 1950er Jahren namens AZ-58 mit diesen sehr niedrigen Audiofrequenzen verwendete. Seine Tests kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Im Folgenden finden Sie zwei seiner Aussagen. Wir zitieren:

DR. STAFFORD: *"Bis jetzt ist es uns nicht gelungen, irgendeinen Fall von fortgeschrittener, unheilbarer Malignität zu "heilen". Es scheint in mehreren Fällen, dass wir die Krankheit vorübergehend positiv beeinflusst haben. Es ist schwierig, die psychologische, moralstärkende Wirkung auf den unheilbaren Patienten auszuschließen, wenn wieder eine endgültige Anstrengung zu seinen Gunsten unternommen wird. Einige Verbesserungen scheinen jedoch eher körperlicher als emotionaler Natur zu sein... Alle Patienten in der Serie wurden mit den gleichen Häufigkeiten behandelt (z. B. 728 - 784 - 880 - 2008 - 2128). Vielleicht sind diese Frequenzen falsch oder nur annähernd richtig."* (John Marsh Collection, Dr. Stafford's Report on using the AZ-58, Seite 4).

DR. STAFFORD: *"Bitte entschuldigen Sie mein Format in dem folgenden Brief, denn ich beabsichtige, ein wenig abzuschweifen und strenge grammatikalische Vorschriften zu vergessen. Ich schreibe Ihnen zu diesem Zeitpunkt, zum Teil, weil John Marsh mir in einem kürzlich erschienenen Brief mitteilt, dass Sie vielleicht etwas entmutigt oder zumindest besorgt über Ihre Rolle bei den Experimenten mit der Rife-Maschine sind. Glauben Sie mir, Dr. Edward, ich weiß, wie Sie sich fühlen, denn auch ich habe das gleiche Gefühl in dieser Angelegenheit durchgemacht. Ich habe klinische Ergebnisse nach Behandlungen mit diesem*

Gerät beobachtet, die ich selbst kaum glauben kann. Doch trotz dieser guten Ergebnisse wurde ich durch einige eher einfache Fehlschläge verwirrt, wie z.B. ein kürzliches Experiment, das ich im Good Samaritan Hospital durchführte, wo wir das Gerät zur Behandlung einiger Kulturen von Staph Aureus und Strept verwendeten. Fäkalis. In dieser Arbeit ist es uns nicht gelungen, das Wachstum zu hemmen oder die Kulturen mit dem Rife Rx zu beeinflussen. Ich schickte die Ergebnisse an John Marsh und bat um Klarstellung, und um ganz ehrlich zu sein, bin ich mit Johns Entschuldigung für das Versagen, wie sie von Dr. Rife beschrieben wurde, nicht zufrieden. Ich fürchte, ich bin kein sehr guter Apostel, denn ich bekomme selbst einige Ideen, wie diese Sache funktionieren könnte. Ich frage mich wirklich, ob dieser Ultraschall überhaupt Bakterien und Viren abtötet oder ob er wie andere Formen von Ultraschall funktioniert und das Gewebe nur auf ungewöhnliche Weise stimuliert, wodurch die Durchblutung verbessert und sekundär die Abwehrkräfte des Körpers gegen Infektionen gestärkt werden... Um einige dieser Geschwafel zusammenzufassen: Ich habe das Gefühl, dass die Rife-Ultraschalltherapie eine sehr positive Wirkung auf den menschlichen (und hündischen) Körper hat... Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass wir als Mediziner, die dieses Gerät verwenden, ständig auf den Zustand unseres Patienten achten und die Rx nach Indikation variieren müssen." (Brief von Dr. Stafford an Dr. Edward Jeppson vom 1. April 1958)

Aus den obigen Zitaten geht hervor, dass Dr. Stafford M.D. in Frage stellte, ob die Audiofrequenzen korrekt waren. Es ist offensichtlich, dass die niedrigen Tonfrequenzen, die im Barmherzigen Samariterkrankenhaus getestet wurden, nicht funktionierten. Im Jahr 1976 ließ John Marsh das Mikrobiologielabor der Brigham Young University dieselben niedrigen Audiofrequenzen testen. Dieser Test ergab die gleichen negativen Ergebnisse, die Dr. Stafford im Good Samaritan Hospital erlebte. Unter dem folgenden Link finden Sie den vollständigen Testbericht, der nach Abschluss der Tests an John Marsh gesendet wurde. Der Schlußbericht datiert vom 31. März 1977.

John Marshs Instrumententest an der Brigham Young University vom 31. März 1977

Der AZ-58 Rife Ray #5 oder Beam Ray Clinical Replica hätte die höheren harmonischen Seitenbandfrequenzen ausgeben können, die Philip Hoyland in diesem Instrument verwendete, wenn sie nur verstanden hätten, wie es wirklich funktioniert. Was auch immer Dr. Stafford von Dr. Rife durch John Marsh gesagt wurde, es befriedigte Dr. Staffords Bedenken nicht. Dr. Rife, John Crane und John Marsh waren wahrscheinlich der Meinung, dass Dr. Stafford nur einige Fehler in seiner Arbeit gemacht hatte, aber das war nicht der Fall. Der Grund, warum sie nicht funktionierten, ist, dass sie die falschen Audiofrequenzen verwendeten, zusammen mit der Tatsache, dass die Maschine falsch eingestellt war, weil sie nicht auf der richtigen HF-Trägerfrequenz (3,30 oder 3,80 Megahertz) war. Das Einzige, was Dr. Stafford versehentlich herausfand, war, dass der AZ-58 die falschen niedrigen Audiofrequenzen verwendete, die nicht die richtigen Hochfrequenz-Seitenbänder erzeugten und keine Organismen im Labor des Krankenhauses töteten. Dr. Rife's wahres Original hohe RF Um diese Ergebnisse

zu erzielen, müssen Frequenzen verwendet werden, entweder direkt oder mit Hilfe der Seitenbandmethode von Philip Hoyland.

Wenn Sie die ursprünglichen hohen HF-Frequenzen von Dr. Rife verwenden möchten, müssen Sie einen Frequenzgenerator verwenden, der seine Frequenzen von 139.200 Hertz bis 1.607.450 Hertz ausgibt. Wenn Sie die höheren harmonischen Frequenzen verwenden möchten, die Philip Hoyland in den Beam Ray Clincial-Instrumenten verwendet hat, müssen Sie einen Frequenzgenerator mit einem höheren Frequenzbereich kaufen. Um einige Generatoren auf dem Markt zu sehen, die in der Lage sind, diese Frequenzen auszugeben, klicken Sie hier.

Zurück zur Startseite